



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
 numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Białystok, dn. 07.08.2018r.

Numer pisma: DA.ZP.242.43.1.2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. J. Śniadeckiego
DZIAŁ ADMINISTRACJI
 Zamówienia Publiczne
 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
 tel. 85 74-88-531, fax 85 74-88-593

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi oraz wyposażenia do Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki, oznaczenie postępowania DA.ZP.242.43.2018.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespólny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania i odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz z wyposażeniem - szt.1 – pkt 2 oraz Załącznik nr 7A do siwz – Projekt umowy (Pakiet nr 1) – § 2 pkt 2.4.

Zamawiający wymaga:

2	Aparat nowy nie używany rok produkcji 2018, wyklucza się aparaty demo i powystawowe.	Tak	bez oceny	
---	--	-----	-----------	--

- Czy Zamawiający wyjaśni oczywistą pomyłkę pisarską i zmieni zapis na:?

2	Aparat nowy nie używany rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018, wyklucza się aparaty demo i powystawowe.	Tak	Bez oceny	
---	---	-----	-----------	--

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SIWZ:

- W Załączniku nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

Zmianie ulega zapis:

1. „Rok produkcji 2018 (sprzęt fabrycznie nowy)” na zapis „Rok produkcji nie wcześniej niż 2018r.”



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

2. Część A pkt. 2: „Aparat nowy nie używany rok produkcji 2018, wyklucza się aparaty demo i powystawowe.” Na zapis: „Aparat nowy nie używany rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018, wyklucza się aparaty demo i powystawowe.”

- W Załączniku nr 7A do SIWZ – Projekt umowy (Pakiet nr 1) w § 2 pkt 2.4.
z: wyprodukowany w 2018 r.
na: rok produkcji nie wcześniej niż 2018r.

Pytanie nr 2:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz z wyposażeniem - szt.1 – pkt 3 i 126.

Zamawiający wymaga:

3	System składający się z: ➤ (..) ➤ osłony przed promieniowaniem X na górne części ciała w postaci szyby ze szkła ołowiowego mocowanej do kolumny na suficie na ramieniu o długości min 180 cm ➤ lampy LED (min 80000 lux) do oświetlania pola cewnikowania mocowana do sufitu (...)	Tak	Bez oceny	
126	Lampa LED (min 80000 lux) do oświetlania pola cewnikowania mocowana do sufitu mocowana na ramieniu o długości min 180 cm	Tak	Bez oceny	

- Czy Zamawiający zmieni zapisy na:

3	System składający się z: ➤ (..) ➤ osłony przed promieniowaniem X na górne części ciała w postaci szyby ze szkła ołowiowego mocowanej do kolumny na suficie na ramieniu o długości min 140 cm ➤ lampy LED (min 50000 lux) do oświetlania pola cewnikowania mocowana do sufitu (...)	Tak	Bez oceny	
---	--	-----	-----------	--

ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

126	Lampa LED (min 50000 lux) do oświetlania pola cewnikowania mocowana do sufitu mocowana na ramieniu o długości min 140 cm	Tak	Bez oceny	
-----	--	-----	-----------	--

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania 1 szt lampy LED.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmianę zapisu pkt. 3 i pkt. 126 Załącznika nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1) na:

1. Pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„System składający się z:

- Zespołu pozycjonowanie pacjenta, generatora RTG, lampy RTG, rentgenowskiego toru obrazowania, cyfrowego systemu rejestracji obrazów,
- osłony przed promieniowaniem X na dolne części ciała w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanej do stołu pacjenta
- osłony przed promieniowaniem X na górne części ciała w postaci szyby ze szkła ołowiowego mocowanej do kolumny na suficie na ramieniu o długości min 140 cm
- lampy LED (min 50000 lux) do oświetlania pola cewnikowania mocowana do sufitu
- UPS min 60 kVA gwarantującego bezprzerwowo (bez konieczności restartu którejkolwiek z części angiografu w trakcie przełączenia na i z zasilania awaryjnego - z możliwością kontynuowania badania, bez konieczności jego zakończenia, na zasilaniu awaryjnym i po przejściu na zasilanie główne) podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiokardiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 5 minut; z zapewnieniem ciągłości obrazowania radiologicznego co najmniej w zakresie fluoroskopii, wszystkich ruchów ramienia, i pełnej funkcjonalności systemu cyfrowego w wymaganym czasie.
- Zestawu ochrony osobistej dla personelu (min 10 kpl)
- Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem wyposażony w czujnik położenia głowicy zabezpieczający przed przypadkowym wstrzykiwaniem:
 - Zakres prędkości wymuszonego przepływu minimum 0,1 – 40 ml/s
 - Zakres ciśnienia programowania minimum 100-1200 PSI
 - Głowica wstrzykiwacza wyposażona we wkłady wymienne o pojemności 150 ml przeznaczone do napełniania dowolnie wybranym środkiem kontrastowym, dowolnego producenta”

Pozostałe zapisy punkt 3 pozostają bez zmian.

2. Pkt. 126 otrzymuje brzmienie:

„Lampa LED (min 50000 lux) do oświetlania pola cewnikowania mocowana do sufitu mocowana na ramieniu o długości min 140 cm .”

Pozostałe zapisy pkt. 126 pozostają bez zmian.

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający wymaga zaoferowania 1 szt lampy LED.



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 13.

Zamawiający wymaga:

13	Zakres badania w osi poprzecznej stołu (np. dostęp do tętnic promieniowych) bez konieczności przemieszczania pacjenta względem stopy stołu)	Min. ± 100 cm	Bez oceny	
----	---	-------------------	-----------	--

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

- Czy Zamawiający zmieni zapis na:?

13	Zakres badania w osi poprzecznej stołu (np. dostęp do tętnic promieniowych) bez konieczności przemieszczania pacjenta względem stopy stołu)	Min. 100 cm	Bez oceny	
----	---	-------------	-----------	--

Powyższa zmiana pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie oferty na urządzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pkt. 13 Załącznika nr 1.1 do SIWZ – Formularz szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1)

Punkt 13 otrzymuje brzmienie:

13	Zakres badania w osi poprzecznej stołu (np. dostęp do tętnic promieniowych) bez konieczności przemieszczania pacjenta względem stopy stołu)	Min. 100 cm	Bez oceny	
----	---	-------------	-----------	--

Pytanie nr 4:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 16 i 17.

Zamawiający wymaga:

16	Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta	Min. $\pm 120^\circ$, podać	Bez oceny	
17	Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta	Min. $\pm 45^\circ$, podać	Bez oceny	

Powyższy zapis nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Zamawiającemu ze względu na referencyjność pracowni oraz zakres wykonywanych zabiegów powinno zależeć na szerokim zakresie zmiany angulacji.

ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

- Czy Zamawiający zmieni zapis na:?

16	Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta	Min. $\pm 120^\circ$, podać	$\geq 300^\circ$ – 10 pkt $< 300^\circ$ – 1 pkt	
17	Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta	Min. $\pm 45^\circ$, podać	$\geq 140^\circ$ – 10 pkt $< 140^\circ$ – 1 pkt	

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 18 i 19.

Zamawiający wymaga:

18	Szybkość ruchów ramienia C w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej)	Min. $20^\circ/s$, podać	Bez oceny	
19	Szybkość ruchów ramienia C w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej)	Min. $20^\circ/s$, podać	Bez oceny	

Powyższy zapis nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Zmawiającemu ze względu na referencyjność pracowni oraz zakres wykonywanych zabiegów powinno zależeć na szybkiej i sprawnej zmianie angulacji.

- Czy Zamawiający zmieni zapis na:?

18	Szybkość ruchów ramienia C w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej)	Min. $20^\circ/s$, podać	$\geq 30^\circ/s$ – 10 pkt $< 30^\circ/s$ – 1 pkt	
19	Szybkość ruchów ramienia C w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej)	Min. $20^\circ/s$, podać	$\geq 30^\circ/s$ – 10 pkt $< 30^\circ/s$ – 1 pkt	

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Pytanie nr 6:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 27.

Zamawiający wymaga:

27	Możliwość zmiany angulacji ramienia C przez operatora stojącego przy głowie pacjenta – dodatkowy pulpit sterujący	Tak	Bez oceny	
----	---	-----	-----------	--

Powyższy zapis nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Zmawiający wymaga dodatkowego pulpitu, który dubluje funkcjonalność pulpitu głównego.

- Czy Zamawiający wyjaśni oczywistą pomyłkę pisarską i zmieni zapis na:?

27	Możliwość zmiany angulacji ramienia C przez operatora stojącego przy głowie pacjenta	Tak	Bez oceny	
----	--	-----	-----------	--

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 3 oraz pkt 127

W punkcie 3 opisano wymagany do zaoferowania wstrzykiwacz kontrastu. Natomiast w pkt. 127 opisano wymóg integracji angiografu z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania wstrzykiwacza czy wymaga intergracji z posiadanym wstrzykiwaczem.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 29a.

Zamawiający wymaga:

29	a) Długość płyty pacjenta 284 cm	Tak, podać	Bez oceny	
----	----------------------------------	------------	-----------	--



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
 numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

- Czy Zamawiający wyjaśni oczywistą pomyłkę pisarską i zmieni zapis na:?

29	a) Długość płyty pacjenta min 284 cm	Tak, podać	Bez oceny	
----	--------------------------------------	------------	-----------	--

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pkt. 29b) Załącznika nr 1.1 do SIWZ Formularz szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1). Zamawiający uznał, że w treści pytania doszło do omyłki pisarskiej w numerze punktu powinno być 29b zamiast 29a. Parametr którego pytanie dotyczy jest pod punktem 29 b).

Punkt 29 b) otrzymuje brzmienie:

29	b) Długość płyty pacjenta min 284 cm	Tak, podać	Bez oceny	
----	--------------------------------------	------------	-----------	--

Pytanie nr 9:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 31.

Zamawiający wymaga:

31	Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii (łącznie ze zmianą prędkości akwizycji), zapisem obrazów fluoroskopowych oraz funkcjami systemu z panelu z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów bezpośrednio przy s pacjenta	Tak	Bez oceny	
----	--	-----	-----------	--

- Czy Zamawiający wyjaśni oczywistą pomyłkę pisarską i zmieni zapis na:?

31	Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii (łącznie ze zmianą prędkości akwizycji), zapisem obrazów fluoroskopowych oraz funkcjami systemu z panelu z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów bezpośrednio przy stole pacjenta	Tak	Bez oceny	
----	--	-----	-----------	--

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
 numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pkt. 31 Załącznika nr 1.1 do SIWZ Formularz szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1).

Punkt 31 otrzymuje brzmienie:

31	Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii (łącznie ze zmianą prędkości akwizycji), zapisem obrazów fluoroskopowych oraz funkcjami systemu z panelu z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów bezpośrednio przy stole pacjenta	Tak	Bez oceny	
----	--	-----	-----------	--

Pytanie nr 10:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 48.

Zamawiający wymaga:

48	Moc największego ogniska	Podać	≥ moc największa ogniska generatora – 10 pkt < zaoferowanej mocy generatora – 0 pkt	
----	--------------------------	-------	--	--

Powyższy zapis jest nie jednoznaczny i pozwala na dowolność interpretacji.

- Czy Zamawiający wyjaśni oczywistą pomyłkę pisarską i zmieni zapis na:?

48	Moc największego ogniska	Podać	moc największego ogniska ≥ zaoferowanej mocy generatora – 10 pkt < zaoferowanej mocy generatora – 0 pkt	
----	--------------------------	-------	---	--

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pkt. 48 Załącznika nr 1.1 do SIWZ Formularz szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1).



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
 numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Punkt 48 otrzymuje brzmienie:

48	Moc największego ogniska	Podać	moc największego ogniska ≥ zaoferowanej mocy generatora – 10 pkt < zaoferowanej mocy generatora – 0 pkt	
----	--------------------------	-------	---	--

Pytanie nr 11:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 63.

Zamawiający wymaga:

63	Płaski detektor cyfrowy o wymiarach pola widzenia (FOV) min. 20x20 cm i max 30x30 cm)	Tak, podać	≥ (20 x 20 cm) < (25 x 25 cm) – 10 pkt. 30 x 30 cm – 50 pkt	
----	---	------------	---	--

Powyższy zapis jest nie jednoznaczny i pozwala na dowolność interpretacji.

- Czy Zamawiający wyjaśni oczywistą pomyłkę pisarską i zmieni zapis na:?

63	Płaski detektor cyfrowy o wymiarach pola widzenia (FOV) min. 20x20 cm i max 30x30 cm)	Tak, podać	≥ (20 x 20 cm) i < (25 x 25 cm) – 0 pkt. ≥ (25 x 25 cm) < (30 x 30 cm) – 10 pkt 30 x 30 cm – 50 pkt	
----	---	------------	---	--

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pkt. 63 Załącznika nr 1.1 do SIWZ Formularz szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1).



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczeniaardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
 numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Punkt 63 otrzymuje brzmienie:

63	Płaski detektor cyfrowy o wymiarach pola widzenia (FOV) min. 20x20 cm i max 30x30 cm)	Tak, podać	20 x 20 cm i < 25 x 25 cm – 0 pkt. 25 x 25 cm < 30 x 30 cm – 10 pkt 30 30 cm – 50 pkt	
----	---	------------	--	--

Pytanie nr 12:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 66.

Zamawiający wymaga:

66	Ilość pól widzenia (FOV)	Min. 4, podać ilość i wymiary [cm x cm]	Bez oceny	
----	--------------------------	---	-----------	--

Powyższy zapis jest nie jednoznaczny i pozwala na dowolność interpretacji.

- Czy Zamawiający wyjaśni oczywistą pomyłkę pisarską i zmieni zapis na:?

66	Ilość pól powiększeń live	Min. 4, podać ilość i wymiary [cm x cm]	≥ 10 – 10 pkt < 10 – 0 pkt	
----	---------------------------	---	-------------------------------	--

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 68.

Zamawiający wymaga:

68	Głębina bitowa detektora	Min. 14 bit, podać	14 bit – 0 pkt. 15 bit – 2 pkt. 16 bit i więcej – 5 pkt.	
----	--------------------------	--------------------	--	--

Powyższy zapis nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Zwiększenie granicznej wartości głębi bitowej detektora pozwoli Zamawiającemu na zakup sprzętu nowoczesnego zwiększając możliwości diagnostyczne.



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

- Czy Zamawiający zmieni zapis na:?

68	Głębina bitowa detektora	Min. 16 bit, podać	Bez oceny	
----	--------------------------	-----------------------	-----------	--

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 71.

Zamawiający wymaga:

71	Typowa wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm	Min. 75%, podać	≥ 77% – 10 pkt < 77% – 0 pkt	
----	--	-----------------	---------------------------------	--

Powyższy zapis nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji parametru i zmieni zapis na:?

71	Typowa wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm	Min. 75%, podać	Bez oceny	
----	--	-----------------	-----------	--

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 66.

Zamawiający wymaga:

66	W sterowni monitory typu "flat" (TFT/LCD): min. 4 monitory obrazowe (≥ 19") live, referencyjny, min. 1 monitor parametrów hemodynamiki min 19"	Tak	Bez oceny	
----	--	-----	-----------	--

Zamawiający przewiduje prezentację obrazów live i referencyjnego

- Czy Zamawiający wyjaśni oczywistą pomyłkę pisarską i zmieni zapis na:?

ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

66	W sterowni monitory typu "flat" (TFT/LCD): min. 2 monitory obrazowe (≥ 19") live, referencyjny, min. 1 monitor parametrów hemodynamiki min 19"	Tak	Bez oceny	
----	--	-----	-----------	--

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.

Odpowiedź:

Zamawiający uznał, że w treści pytania doszło do omyłki pisarskiej i dotyczy ono punktu 76, w którym występuje parametr, którego dotyczy pytanie.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pkt. 76 Załącznika nr 1.1 do SIWZ Formularz szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1).

Punkt 76 otrzymuje brzmienie:

76	W sterowni monitory typu "flat" (TFT/LCD): min. 2 monitory obrazowe (≥ 19") live, referencyjny, min. 1 monitor parametrów hemodynamiki min 19"	Tak	Bez oceny	
----	--	-----	-----------	--

Pytanie nr 16:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 87.

Zamawiający wymaga:

87	Przystony sterowane niezależnie umożliwiające wybór dowolnego położenia obszaru ograniczonego przysłoną prostokątną (dla każdego FOV detektora) bez konieczności manipulowania stołem / pacjentem, możliwość wyboru obszaru położonego poza centrum pola widzenia w całym obszarze pola detektora (kolimacja asymetryczna względem środka pola detektora) z dynamicznym systemem zmiany wielkości pola pomiarowego systemu ABC (Automatic Brightness Control) ograniczający rozmiar pola do rozmiaru nie większego niż obszar skolimowany dla dowolnego wymiaru kolimacji	Tak	Tak - 20 pkt Nie – 0 pkt	
----	---	-----	-----------------------------	--



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
 numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Powyższy zapis nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Czy Zamawiający zmieni wagę punktacji dla tego parametru .

- Czy Zamawiający zmieni wagę punktacji dla tego parametru i zmieni zapis na:?

87	Przysłony sterowane niezależnie umożliwiające wybór dowolnego położenia obszaru ograniczonego przysłoną prostokątną (dla każdego FOV detektora) bez konieczności manipulowania stołem / pacjentem, możliwość wyboru obszaru położonego poza centrum pola widzenia w całym obszarze pola detektora (kolimacja asymetryczna względem środka pola detektora) z dynamicznym systemem zmiany wielkości pola pomiarowego systemu ABC (Automatic Brightness Control) ograniczający rozmiar pola do rozmiaru nie większego niż obszar skolimowany dla dowolnego wymiaru kolimacji	Tak	Tak - 50 pkt Nie – 0 pkt	
----	---	-----	-----------------------------	--

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 107.

Zamawiający wymaga:

107	Funkcjonalność tworzenia barwnych map dawki prezentujące rozkład dawki na ciele pacjenta w czasie rzeczywistym podczas ekspozycji z możliwością wyboru przedziału wagowego oraz proporcji ciała pacjenta	Tak/Nie	Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt.	
-----	--	---------	-------------------------------	--

Powyższy zapis nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Czy Zamawiający zmieni wagę punktacji dla tego parametru .

- Czy Zamawiający zmieni wagę punktacji dla tego parametru i zmieni zapis na:?



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
 numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

107	Funkcjonalność tworzenia barwnych map dawki prezentujące rozkład dawki na ciełe pacjenta w czasie rzeczywistym podczas ekspozycji z możliwością wyboru przedziału wagowego oraz proporcji ciała pacjenta	Tak/Nie	Tak – 50 pkt. Nie – 0 pkt.	
-----	--	---------	-------------------------------	--

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 266.

Zamawiający wymaga:

127	(...) Procesor: min. czterocorowy procesor osiągający w teście PassMark - CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) na dzień 12.03.2018 roku wynik min. 8300 punktów (...)	Tak	Bez oceny	
-----	--	-----	-----------	--

Powyższy zapis nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Zmawiający wymaga min. 8300 punktów na dzień 12.03.2018 roku ale na dzień dzisiejszy na stronie www.cpubenchmark.net nie ma możliwości sprawdzenia archiwalnych wyników.

- Czy Zamawiający posiada listę wyników testów PassMark - CPU Mark ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) na dzień 12.03.2018 roku? Jeśli tak prosimy o udostępnienie ze względu na brak możliwości sprawdzenia archiwalnych wyników testów na dzień 12.03.2018r. Możliwość sprawdzania archiwalnych wyników testów na stronie www.cpubenchmark.net jest aktualnie niedostępna.
- Prosimy o dopuszczenie do postępowania procesora serwera uzyskującego 8294 punkty w teście PassMark - CPU Mark ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) na dzień 23.07.2018 roku. Jest to jedynie 6 punktów mniej niż wymagane przez Zamawiającego.
- Czy w związku z faktem, że możliwość sprawdzania z datą wsteczną jest wyłączona, czy Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty dokumentu typu „print screen” ze strony PassMark dla zaoferowanego procesora z dnia 23.07.2018 jak poniżej?




ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

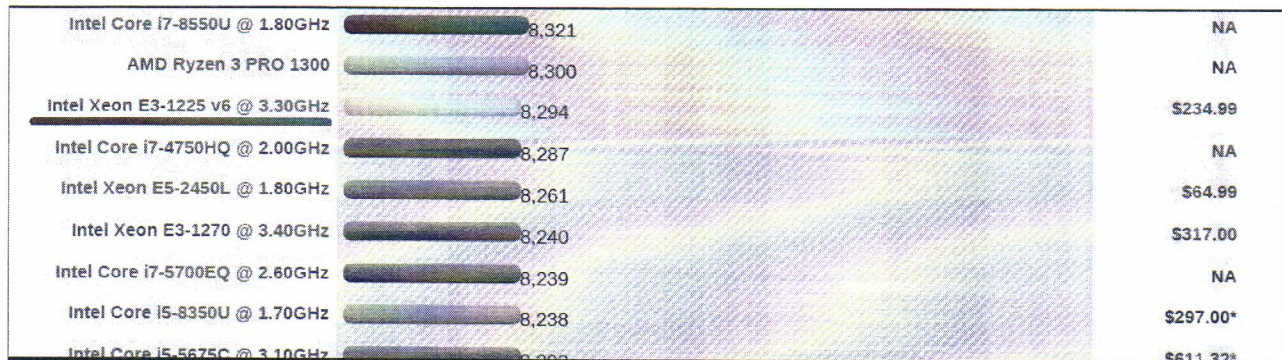

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada listy wyników. Zamawiający dopuszcza procesor z wynikiem min. 8290 pkt. zamawiający dopuszcza „print screen” z dnia nie wcześniej niż 23.07.2018r.

Pytanie nr 19

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt. 265, pkt 266. Pkt. 270 oraz rozdział 25 pkt. A.c)

INFRASTRUKTURA SERWEROWA komplet				
266	Gwarancja Producenta: Min. 36 miesięcy, następnego dnia roboczego, w miejscu instalacji.	Tak	Bez oceny	
270	Gwarancja na cały oferowany system	Tak min 24 miesiące.	Bez oceny	
265	Stacja diagnostyczna obejmująca jednostkę sterującą i monitor referencyjny Okres gwarancji 36 miesięcy	Tak	Bez oceny	

rozdział 25 pkt. A.c)

„zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące”

Ze względu na rozbieżności w opisie wymaganego okresu gwarancji, prosimy o wyjaśnienie, że Zamawiający wymaga minimalnej gwarancji wynoszącej min. 24 miesiące dla całego zakresu przedmiotu zamówienia, czyli angiografu oraz systemu PACS. Zamawiający przyjął gwarancję jako jedno z kryteriów ocenianych i ocenia ją łącznie dla angiografu i systemu PACS w związku z tym jest istotne aby okres minimalnej gwarancji był określony jednolicie dla całego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi urządzeń nie może być krótszy niż 24 miesiące.



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy pkt. 266 i pkt. 265.

Okres gwarancji min. 24 miesiące.

Punkty 266, 270, 265 otrzymują brzmienie:

INFRASTRUKTURA SERWEROWA komplet				
266	Gwarancja Producenta: Min. 24 miesiące, następnego dnia roboczego, w miejscu instalacji.	Tak	Bez oceny	
270	Gwarancja na cały oferowany system	Tak min 24 miesiące.	Bez oceny	
265	Stacja diagnostyczna obejmująca jednostkę sterującą i monitor referencyjny Okres gwarancji min. 24 miesiace	Tak	Bez oceny	

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien w złożonej ofercie zaoferować jeden termin gwarancji urządzeń w zakresie danego pakietu (okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert).

Pytanie nr 20

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt. IX

Zamawiający wymaga w tym punkcie:

IX	System PACS ze stacją przeglądowną i integracją z systemem szpitalnym.			
----	--	--	--	--

Czy Zamawiający potwierdza, że poprzez "integracja z systemem szpitalnym" rozumie przesyłanie obrazów z dostarczonego systemu PACS do szpitalnego systemu PACS ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Pytanie dotyczy załącznika 1.1 punkt 3:

Czy zamawiający wymaga wstrzykiwacza z menu w języku polskim i przewodnikiem dla użytkownika wyświetlanym na panelu sterującym ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

=====



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Pytania do Pakietu nr 2

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznik nr 1.2 do siwz – formularz szczegółowy oferty (Pakiet nr 2) pkt 119

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w treści wymogu w pkt. 119

Jest:

Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną – inne niż opisane w <u>pkt. II.11-17</u>	Tak / Nie	Możliwość rozbudowy- 20pkt. Nie – 0 pkt.
--	-----------	---

Powinno być:

Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną – inne niż opisane <u>w pkt. 46-52</u>	Tak / Nie	Możliwość rozbudowy- 20pkt. Nie – 0 pkt.
---	-----------	---

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pkt. 119 Załącznika nr 1.2 do SIWZ Formularz szczegółowy Oferty (Pakiet nr 2).

Punkt 119 otrzymuje brzmienie:

119	Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną – inne niż opisane <u>w pkt. 46-52</u>	Tak / Nie	Możliwość rozbudowy- 20pkt. Nie – 0 pkt.	
-----	---	-----------	---	--

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznik nr 1.2 do siwz – formularz szczegółowy oferty (Pakiet nr 2) pkt 120

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w pkt. 120

Jest:

Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na <u>zaoferowanej</u> sondzie convex i linia	Tak Podać typy sond	Bez oceny
---	---------------------	-----------



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
 numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Powinno być:

Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na zaoferowanej sondzie convex i linia	Tak Podać typy sond	Bez oceny
--	---------------------	-----------

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga zaoferowania sondy convex oraz linia.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pkt. 120 Załącznika nr 1.2 do SIWZ Formularz szczegółowy Oferty (Pakiet nr 2).

Punkt 120 otrzymuje brzmienie:

Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondzie convex i linia	Tak Podać typy sond	Bez oceny
---	---------------------	-----------

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznika nr 1.2 do siwz – formularz szczegółowy oferty (Pakiet nr 2) pkt 124

Zamawiający wymaga zaoferowania 5 zestawów holtera EKG – pkt. 124. Jednocześnie w niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga dostawy zestawów holtera EKG w pakiecie nr 3.

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania holterów również w pakiecie nr 2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostawy holterów w Pakiecie nr 2. W związku z powyższym punkt 124 zostaje wykreślony.

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznika nr 1.2 do siwz – formularz szczegółowy oferty (Pakiet nr 2) pkt 36

Zamawiający wymaga Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowy – min. 40 cm

Czy Zamawiający dopuści do przetargu Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowy – min. 38 cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznika nr 1.2 do siwz – formularz szczegółowy oferty (Pakiet nr 2) pkt 102.

Zamawiający wymaga Liczba elementów akustycznych – 800

Czy Zamawiający dopuści głowicę posiadającą 600 elementów akustycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznika nr 1.2 do siwz – formularz szczegółowy oferty (Pakiet nr 2) pkt 117.

Zamawiający wymaga „Możliwość rozbudowy o specjalne oprogramowanie pokazujące napływ małych porcji kontrastu i rekonstruujące ich drogę przemieszania się wewnątrz naczyń”

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetargu bez funkcjonalności „Możliwość rozbudowy o specjalne oprogramowanie pokazujące napływ małych porcji kontrastu i rekonstruujące ich drogę przemieszania się wewnątrz naczyń”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

=====

Pytania do Pakietu nr 3

Dotyczy Pakietu nr 3

Poz. 1 – Aparat EKG

Pytanie nr 1: Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści wbudowane zasilanie akumulatorowe na 2 godziny ciągłego monitorowania i rejestracji?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 2: Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści wbudowany, duży ekran graficzny o przekątnej 7 cali?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 3: Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści zapis na papierze termicznym o szerokości 210 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 4: Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści prędkość przesuwu papieru 5; 12,5; 25; 50 mm/s?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 5: Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści prędkość przesuwu papieru 5; 25; 50 mm/s?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 6: Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści aparat, który umożliwia zapis i odczyt kopii badania na karcie SD?

Odpowiedź: Dopuszczamy.



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Poz. 2 - Zestaw holterów

Pytanie nr 1: Pkt. 1g Czy Zamawiający dopuści pamięć cyfrową zainstalowaną na stałe?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 2: Pkt. 1h Czy Zamawiający dopuści zasilanie baterią alkaliczną typu AA1,5V?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 3: Pkt. 2n Czy Zamawiający dopuści masę ok. 140 g bez baterii?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 4: Pkt. 2o Czy Zamawiający dopuści analizę w trybie retrospektywnym?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

=====

Pytania do pakietu nr 4

Pakiet nr 4 Respirator transportowy – 1 szt

Pytanie nr 1: Lp.4 Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator na podstawie jednej z blokadą kół, podstawa wyposażona w uchwyt dla dwóch min. 2,7 l butli z tlenem, 2 butle i 1 reduktor do tlenu z przyłączem AGA?

Odpowiedź: Dopuszczamy, z przyłączem DIN.

Pytanie nr 2: Lp.5 Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator bez uchwytu do połączenia respiratora na wózek pacjenta na czas transportu? Respirator nasz można w bardzo prosty sposób zdjąć z podstawy i umieścić na łóżku pacjenta na czas transportu.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 3: Lp.7c Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniem wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej w zakresie 5-80 cmH₂O?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 4: Lp.7g Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator z zakresem temperatury pracy od 5 stopni do 40 stopni?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

=====



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Pytania do Pakietu nr 5

Dotyczy pakietu nr 5 - Zestaw pomp infuzyjnych strzykawkowych

Pytanie nr 1: Dot. pkt 1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową skalibrowaną do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (95 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim)?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 2: Dot. pkt 2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową, w której mocowanie strzykawki odbywa się całkowicie manualnie, do czoła pompy? Taki system umożliwi mocowanie strzykawki zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie. Podczas pracy pompy cała strzykawka jest stale widoczna, z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 3: Dot. pkt 4 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową z zakresem szybkości infuzji 0,1-1200ml/h?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 4: Dot. pkt 5 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową o dokładności regulacji szybkości przepływu : $\pm 1\%$ w mechanizmie oraz $\pm 2\%$ w strzykawkach?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 5: Dot. pkt 9 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową z możliwością programowania dawki nasycającej: Dawka/czas: 0,01-9999 jedn./ 1 sekundę – 24 h Automatyczne obliczanie szybkości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 6: Dot. pkt 10 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową z możliwością programowania infuzji w następujących jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, $\mu\text{g}/\text{min}$, $\mu\text{g}/\text{h}$, $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$, $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{h}$, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/ml/h, mg/ml/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 7: Dot. pkt 11 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową posiadającą bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Pytanie nr 8: Dot. pkt 12 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową zawierającą 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków . Biblioteka leków zawiera 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, limity miękkie i twarde, stężenia itp.)?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 9: Dot. pkt 20 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową, w której czas całkowitego naładowania baterii przy wyłączonej pompie wynosi 6 godzin?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 10: Dot. pkt 24 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym w języku angielskim?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

=====

Pytania do Pakietu nr 7

Pytanie nr 1: Zwracamy się do zamawiającego z pytaniem czy nie doszło do omyłki pisarskiej w pakiecie siódmym część A punkt 14, według naszej wiedzy nie istnieją urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej wyposażone we wymienione elementy, w związku z tym czy przypadkiem te parametry nie zostały błędnie wypisane z innego pakietu, dlatego też prosimy o ich wykreślenie z OPZ?

Odpowiedź: W Pakiecie nr 7 w opisie urządzenia do kompresji klatki piersiowej doszło do omyłki pisarskiej. Z opisu ww. wymienionego przedmiotu zamówienia zostaje wykreślony punkt 14 i punkt. 15.

W Załączeniu do pisma Formularz Szczegółowy Ofert (Pakiet nr 7) – Załącznik nr 1.7 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami.

Pytanie nr 2: Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej cenionego europejskiego producenta o poniższych parametrach przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ?

- Automatyczny dobór sił ucisku uwzględniający opór klatki piersiowej z samoczynnym odprężeniem klatki piersiowej do pozycji wyjściowej (fizjologiczna relaksacja klatki piersiowej)
- System stabilizacji pacjenta bez konieczności stosowania dodatkowej podkładki pod głowę, ze system mocowania rąk pacjenta wzdłuż osi ciała - takie rozwiązanie wynika z konstrukcji proponowanego urządzenia



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Odpowiedź:

Dopuszczamy urządzenie z „automatyczny dobór sił ucisku uwzględniający opór klatki piersiowej z samoczynnym odprężeniem klatki piersiowej do pozycji wyjściowej (fizjologiczna relaksacja klatki piersiowej)” .

Nie dopuszczamy urządzenia z „system stabilizacji pacjenta bez konieczności stosowania dodatkowej podkładki pod głowę, ze system mocowania rąk pacjenta wzdłuż osi ciała - takie rozwiązanie wynika z konstrukcji proponowanego urządzenia”.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej mogło pracować na jednym akumulatorze co najmniej 60 min - takie rozwiązanie pozwoli państwu na gotowość urządzenia do pracy nawet podczas kolejnego zabiegu angioplastyki naczyń wieńcowych, w sytuacji w której zaraz po pierwszym pacjencie wymagany jest drugi zabieg?

Odpowiedź: Nie wymagamy.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wymaga aby płyta pod plecy pacjenta była przezierna dla promieni rentgenowskich - takie rozwiązanie zapewni państwu większe możliwości diagnostyczne oraz zwiększy bezpieczeństwo zabiegu?

Odpowiedź: Wymagamy.

Pytanie nr 5:

Załącznik nr 1.7 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 7)

Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej:

W związku z tym, że prawdopodobnie nastąpiła pomyłka podczas opisywania przedmiotu zamówienia, prosimy o wykreślenie punktów 14 i 15 specyfikacji, ponieważ opisane parametry dotyczą innego urządzenia medycznego.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 7 w opisie urządzenia do kompresji klatki piersiowej doszło do omyłki pisarskiej. Z opisu ww. wymienionego przedmiotu zamówienia zostaje wykreślony punkt 14 i punkt. 15.

W Załączeniu do pisma Formularz Szczegółowy Ofert (Pakiet nr 7) – Załącznik nr 1.7 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami.

Pytanie nr 6:

Załącznik nr 1.7 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 7)

Defibrylator dwufazowy

Czy zamawiający opisując parametr „komplet 5 końcówek EKG z klipsami” ma na myśli elektrody samoprzylepne do wykonywania defibrylacji, stymulacji i kardiowersji wraz z przewodem połączeniowym?

Odpowiedź: Nie.

=====



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Pytania do Projektu umowy.

Pytanie nr 1:

Dotyczy §4 ust. 1.7 oraz § 7 ust. 1 Wzoru Umowy: Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów, regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za używanie aparatów, a w tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Aparaty stanowiące przedmiot zamówienia są urządzeniami, których używanie ma szczególny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie ich napraw i przeglądów serwisowych wymaga zaawansowanego przeszkolenia.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi serwisowej do wykonywania drobnych napraw i przeglądów dostarczonych urządzeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy §11 ust.8 Wzoru Umowy: Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Prosimy o zmianę treści ust. 8 na następującą:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu lub podzespołu na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego elementu lub podzespołu, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Sprzętu - w terminie 7 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3:

Dotyczy §11 ust.11 Wzoru Umowy: Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Pytanie nr 4:

Dotyczy § 14 ust. 1 Wzoru Umowy: W naszej opinii zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu wad. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Załącznik nr 7A do siwz – Projekt umowy (Pakiet nr 1) – § 2 pkt 2.6.

Zamawiający wymaga:

(...) wyposażony w najaktualniejszą, pełną i polskojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnioną o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej, niezbędne do jego funkcjonowania (wyklucza się możliwość instalacji wersji demonstracyjnych, testowych itp.);

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

- Czy Zamawiający wyjaśni oczywistą pomyłkę pisarską i zmieni zapis na:

(...) wyposażony w najaktualniejszą, pełną i angielsko lub polskojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnioną o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej, niezbędne do jego funkcjonowania (wyklucza się możliwość instalacji wersji demonstracyjnych, testowych itp.);

Ze względu na specjalistyczność urządzeń nie praktykuje się dla angiografu menu w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający zgada się na proponowaną zmianę zapisów § 2 pkt. 2.6 projektu umowy – Załącznik nr 7A do SIWZ.

§ 2 pkt. 2.6 projektu umowy – Załącznik nr 7A do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„(...) wyposażony w najaktualniejszą, pełną i angielsko lub polskojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnioną o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej, niezbędne do jego funkcjonowania (wyklucza się możliwość instalacji wersji demonstracyjnych, testowych itp.);”

Pytanie nr 6:

Dotyczy Załącznik nr 7A do siwz – Projekt umowy (Pakiet nr 1) – § 3 pkt 14

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie możliwości realizacji przedmiotu zamówienia na nieruchomości Zamawiającego.

Proponujemy ustalenie możliwości realizacji prac w godzinach od 7 do 19.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wydłużenie godzin określonych w § 3 pkt. 14.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis § 3 pkt 14 i otrzymuje on brzmienie.

„Czynności składające się na wykonanie Przedmiot Umowy na nieruchomości Zamawiającego, Wykonawca realizuje w dni robocze w godz. od 8.00 do 19.00. Termin dostawy, montażu i uruchomienia Systemu Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.”



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Pytanie nr 7:

Dotyczy Załącznik nr 7A do siwz – Projekt umowy (Pakiet nr 1) – § 3 pkt 11

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zapewniania wzajemnej kompatybilności Systemu z wyposażeniem, urządzeniami, instalacjami i oprogramowaniem Zamawiającego, dotyczy urządzeń niezbędnych do funkcjonowania pracowni angiograficznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Załącznik nr 7B do siwz – Projekt umowy (Pakiet nr 2) – § 2 pkt 3.7.

Zamawiający wymaga:

(...) wyposażony w najaktualniejszą, pełną i polskojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnioną o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej, niezbędne do jego funkcjonowania (wyklucza się możliwość instalacji wersji demonstracyjnych, testowych itp.);

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

- Czy Zamawiający wyjaśni oczywistą pomyłkę pisarską i zmieni zapis na:?

(...) wyposażony w najaktualniejszą, pełną i angielsko lub polskojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnioną o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej, niezbędne do jego funkcjonowania (wyklucza się możliwość instalacji wersji demonstracyjnych, testowych itp.);

Ze względu na specjalistyczność urządzeń nie praktykuje się dla aparatu Ultrasonograficznego menu w języku polskim

Odpowiedź: Zamawiający zgada się na proponowaną zmianę zapisów § 2 pkt. 3.7 projektu umowy – Załącznik nr 7B do SIWZ.

§ 2 pkt. 3.7 projektu umowy – Załącznik nr 7B do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„(...)wyposażony w najaktualniejszą, pełną i angielsko lub polskojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnioną o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej, niezbędne do jego funkcjonowania (wyklucza się możliwość instalacji wersji demonstracyjnych, testowych itp.);

Pytania do Załącznika nr 8 do SIWZ

Pytanie 1.

Dotyczy załącznika Załącznik nr 8 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia – Opis prac dostosowawczych - dotyczy Pakietu nr 1

W związku z informacjami uzyskanymi na wizji lokalnej:

- Czy Zamawiający potwierdza, że zakres powierzchni do adaptacji został zwiększony i wynosi 135m²?
- W dokumentacji załączonej do SIWZ, nie ma planu pomieszczeń z zakreślonym zakresem inwestycji. Prosimy o udostępnienie takiego planu, rysunku.



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

- Czy Zamawiający potwierdza, że zakres przebudowy obejmuje jedynie pomieszczenia po prawej stronie (po stronie posiadanego angiografu) korytarza, po przeciwnej stronie sal łóżkowych?
- Czy Zamawiający potwierdza, że zakres prac nie zawiera przebudowy przyległego korytarza?
- Prosimy o informację, jaki jest przekrój obecnie położonego kabla zasilającego, jaka jest jego moc oraz w którym miejscu znajduje się rozdzielnia mocy?
- Czy Zamawiający posiada wolne pole do wpięcia się z siecią rezerwowaną? Czy należy przewidzieć nową instalację wraz z UPS?
- Czy Zamawiający posiada rezerwę mocy rzędu 120 kW w rozdzielni NN? Chodzi nam o rezerwę mocy transformatora oraz o wolne pole w rozdzielni do przyłączenia kabla zasilającego angiograf.

Odpowiedzi na powyższe pytania, pozwolą Wykonawcom na jednoznaczne oszacowanie kosztów adaptacji.

Odpowiedź:

- Zakres do adaptacji zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ pkt. 3 Opis stanu istniejącego wynosi 95,37 m².
- Plan pomieszczeń, rysunek w załączeniu do niniejszego pisma.
- Zakres pomieszczeń do adaptacji określony został w załączniku jak w pytaniu wyżej. Należy jednak pamiętać, iż ze względu na doprowadzenie i odprowadzenie mediów niezbędnych do funkcjonowania pracowni integracja może następować w strukturę innych pomieszczeń, które uzgodnione winny być na podstawie zatwierdzenia przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych przez Wykonawcę.
- Korytarz wchodzi w zakres prac adaptacyjnych w niezbędnym zakresie.
- Zamawiający informuje, że nie ma możliwości zasilania angiografu z istniejącej rozdzielni mocy. Wykonawca musi przewidzieć zasilanie angiografu bezpośrednio z abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
- Zamawiający nie posiada wolnego pola w części rozdzielni rezerwowej. Należy przewidzieć nową instalację wraz z UPS.
- Zamawiający informuje, że posiada rezerwę mocy rzędu 120 kW w rozdzielni nn, w abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Moc istniejącego transformatora pozwala na zasilanie odbioru o mocy 120kW. W rozdzielni nn, w abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV jest wolne pole do przyłączenia kabla zasilającego angiograf.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika Załącznik nr 8 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia – Opis prac dostosowawczych - dotyczy Pakietu nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaze plac budowy przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, w celu wykonywania prac przygotowawczych.

Odpowiedź:

TAK.

=====



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Pytania do SIWZ

Pytanie nr 1:

Dotyczy rozdział 4 SIWZ, pkt. 2 formularza oferty, Terminu wykonania zamówienia - dotyczy Pakietu nr 1

Zamawiający wymaga 6 miesięcznego terminu wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy.

- Prosimy o wysłużenie tego terminu do 9 miesięcy.

Ze względu na terminy urzędowe i technologiczne tj:

- Wykonanie projektu budowlanego (do złożenia w urzędzie dla uzyskania pozwolenia na budowę) to min. 30 dni roboczych – zakładając, że Zamawiający uzgodni roboczą koncepcję a następnie projekt w terminach max. 5 - dni.
 - konieczne jest wykonanie inwentaryzacji (min. 2 dni robocze), koncepcji (min. 4-7 dni robocze), uzgodnień roboczych koncepcji (min. 5 dni robocze),
 - projekt budowlany w tym konstrukcja min. 14 dni roboczych. Zatwierdzenie przez Zamawiającego (min. 7 dni roboczych + dodatkowy czas na uzgodnienia robocze min 14 dni roboczych) i ewentualnej konieczności prowadzenia sieci energetycznej w terenie – uzgodnień roboczych z ZUD dodatkowe min. 30 dni roboczych.
- Uzyskanie pozwolenia na budowę – urząd ma w tym przypadku 60 dni - zakładamy Zamawiający zezwoli na niezwłoczne wejście na roboty po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
- Należałoby dodatkowo odliczyć:
 - czas przeznaczony na czynności odbiorowe – ok 7 dni roboczych
 - czas na montażu aparatu (min 45 dni roboczych), przeszkolenie (min 10 dni roboczych) , uzyskanie koniecznych zezwoleń itd. (min 45 dni roboczych), (w którym to okresie prace budowlane nie mogłyby być praktycznie prowadzone).

Z powyższych wyliczeń wynika, iż na prace budowlane i instalację urządzenia (możliwą po wykonaniu prac) pozostaje max. 7-8 dni roboczych. Szacowany przez nas konieczny czas na wykonanie robót budowlanych to min 90 dni. Dlatego wnosimy o wydłużenie terminu realizacji bez wyszczególnienia terminów poszczególnych etapów do 9 miesięcy od podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiają wydłuża termin realizacji zamówienia w Pakiecie nr 1 do 8 miesięcy.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis Rozdziału nr 4 terminu realizacji zamówienia w zakresie Pakietu nr 1: z 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie Pakietu nr 1 zmianie ulega zapis dotyczący terminu realizacji:

z Termin realizacji zamówienia - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

na Termin realizacji zamówienia - 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Pytanie nr 2

Dotyczy rozdziału 16, pkt. 6.1)

Zamawiający w opisie materiałów firmowych wskazanych do złożenia na wezwanie wymienił również świadectwa rejestracji.

Są to dokumenty mieszczące się w katalogu dokumentów na podstawie których oferowane produkty medyczne mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania. Wymóg złożenia oświadczenia o ich



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

posiadaniu został opisany w pkt 6.2). W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia tych dokumentów na wezwanie wraz z materiałami firmowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający w Rozdziale 16 pkt. 6.1) wymienił przykładowe dokumenty, które powinny potwierdzić, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz powinny potwierdzić wszystkie oferowane parametry. Zamawiający nie wymaga dostarczenia wszystkich dokumentów wyszczególnionych w Rozdziale 16 pkt. 6.1), a tylko tych, które potwierdzą, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i posiada wskazane parametry.

=====

Zamawiający zmienia termin składania oraz otwarcia ofert na dzień 23.08.2018r..

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulegają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Rozdział 23 pkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia 23.08.2018 r. o godz. 11:00.

Rozdział 24 pkt. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2018 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok
Sala Konferencyjna, I piętro, pokój nr 16 (budynek administracji).”

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonej niniejszym pismem.

Pozostałe warunki SIWZ i umowy nie ulegają zmianie. Niniejsza modyfikacja staje się nierozłączną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki do pisma:

1. Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1) po zmianach
2. Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 2) po zmianach
3. Załącznik nr 1.7 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 7) po zmianach
4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Ofertowy po zmianach
5. Załącznik nr 7A do SIWZ – Projekt umowy (po zmianach)
6. Załącznik nr 7B do SIWZ – Projekt umowy (po zmianach)
7. Rysunek , plan

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Joanna Zaręba-Sioma