



PL-BY-UA  
2014-2020

Samodzielny Publiczny ZOZ  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY  
*im. J. Śniadeckiego*  
**DZIAŁ ADMINISTRACJI**  
*Zamówienia Publiczne*  
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26  
tel. 85 74-88-531, fax 85 74-88-593

Białystok, dnia 16.10.2020 r.

Nr pisma: DA.ZP.242.54.1.2020

Wszyscy zainteresowani  
Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej oraz mebli i wyposażenia, oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.54.2020.**

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców:**

#### WYKONAWCA NR 1

**Dot. pakietu nr 7**

Co zamawiający ma na myśli jeśli chodzi o zawór bezpieczeństwa ?

Czy chodzi o zawór odcinający – zaworem tym odcinamy przepływ gazu w dozowniku.

**Odpowiedź:** Zawór bezpieczeństwa powinien zapobiec niekontrolowanemu przepływowi tlenu.

#### WYKONAWCA NR 2

**Dotyczy: Pakiet nr 3 – łóżko intensywnej terapii – 1 szt.**

1. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści łóżko posiadające sekcję tydki regulowaną za pomocą sprężyny gazowej?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

2. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści 4 panele sterujące (2 panele dla pacjenta po stronie wewnętrznej barierki oraz 2 panele dla personelu po stronie zewnętrznej barierki)?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

3. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści główny panel kontrolny dla pielęgniarki z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) znajdujący się po zewnętrznej stronie barierki zabezpieczających na wysokości sekcji oparcia pleców?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

4. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka wyposażoną w dedykowany materac powietrzny, niezależny (nie zintegrowany z łóżkiem) umożliwiający przechylenie pacjenta na boki?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści system ważenia pacjenta bez funkcji wykrywania ruchów pacjenta?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

6. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające systemu antyzgnieciowego?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

7. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wysokość platformy materaca w zakresie 41 – 83 cm?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

8. Czy (w pkt. 13) Zamawiający jako pedały sterujące z każdej strony łóżka ma na myśli sterowanie nożne regulacji wysokości umieszczone po obu stronach łóżka?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**


9. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające pedatów sterujących z każdej strony łóżka?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

10. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści 4 pojedyncze koła zwrotne o średnicy 150 mm?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

11. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w segmencie oparcia pleców w prowadnice oraz tacę na kasetę RTG?

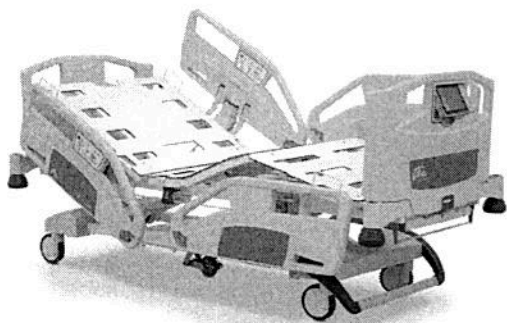

(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

12. Czy (w pkt. 19 – 35) Zamawiający dopuści materac o poniższych parametrach?

- Materac z możliwością dokonywania rotacji bocznej pacjenta w lewą lub prawą stronę wraz z wyborem kąta pochylenia ciała pacjenta
- Rotacja obustronna  $\leq 35^\circ$
- Pompa włączająca powietrze do materaca i utrzymująca zadaną wartość ciśnienia, także naprzemiennie upuszczająca powietrze z jednej z dwóch/trzech sekcji, dopompowująca je z pozostałej sekcji
- Tryb zmienny z funkcją wyboru czasu trwania, tryb statycznym tryb pulsacyjny, tryb pielęgnacyjny
- Materac rotacyjny zbudowany z trzech warstw: górnej, pneumatycznej zmiennociśnieniowej, środkowej wykonanej z pianki PU, spodniej warstwy pneumatycznej, rotacyjnej
- Pompa ultraniskociśnieniowa wartość ciśnienia w materacu od 10 mmHg
- Alarm dźwiękowy i wizualny braku właściwego ciśnienia, braku zasilania, informujący o konieczności przeprowadzenia okresowych czynności serwisowych
- Materac posiadający mikrootwory – system dotleniania uciskanych tkanek

- Materac kładziony bezpośrednio na leżu łóżka
- Stabilny zagłówek, pasy stabilizujące
- Wymiary po napompowaniu wszystkich komór powietrznych 190/200 x 85/90 cm (+/-5%)
- Udźwig materaca do 255 kg
- Pompa materaca zawieszana na łóżku
- Połączenie pompy z materacem realizowany szybkozłączką transportową Dwa pokrowce wykonane z odpornego materiału
- Materac posiadający funkcję transportową
- Blokada panelu sterowania pompy materaca
- Zawór reanimacyjny CPR umożliwiający szybkie opróżnianie powietrza

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

13. Czy (w pkt. 36) Zamawiający dopuści materac bez możliwości obracania na 4 strony?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz  
*mgr Joanna Zaręba-Słoma*