

Białystok, dn. 28.04.2017r.

Numer pisma: DA-ZP-252-19-1/17

**Wszyscy
zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia do Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-19/17.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Zespólny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania do Pakietu nr 1

Wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem – 3 szt

1. Dotyczy Pakietu nr 1 – Wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem – 3 szt - Prosimy o wyrażenie zgody na realizację zamówienia w terminie do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

2. Dotyczy Pakietu nr 1 – Wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem – 3 szt - Czy Zamawiający dopuści **wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem** o poniższych parametrach?
 - Błat roboczy z bandą ograniczającą z trzech stron wykonaną z wysokiej jakości tworzywa ABS.
 - Wózek wyposażony w minimum pięć szuflad z półką nadbłatową.
 - Wyposażony w blat górny posiadający wyprofilowane brzożgi służące jako uchwyty do prowadzenia wózka.
 - Wyposażenie dodatkowe:
 - uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły
 - jedna szyna umożliwiająca montaż sprzętu dodatkowego
 - wyposażony w nadstawkę z uchylnymi pojemnikami na leki i dodatkowy sprzęt oraz wieszakiem na płyny infuzyjne, a także półkę z możliwością podstawienia na niej monitora
 - pojemnik na odpady

- Możliwość wyboru koloru uchwytów do szuflad (do wyboru kolor czerwony, żółty, pomarańczowy, niebieski, granatowy, zielony)

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie blatu roboczego z bandą ograniczającą z trzech stron wykonaną z wysokiej jakości tworzywa ABS warunkując dopuszczenie dostarczeniem odpowiednich atestów pozwalających na zastosowanie rozwiązania w obiektach służby zdrowia w tym przy stosowaniu środków dezynfekujących.
- Wózek wyposażony w minimum pięć szuflad z półką nadblatową zgodnie z opisem zamówienia'
- Zamawiający dopuszcza blat górny posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do prowadzenia wózka,
- Zamawiający wymaga zastosowania minimum dwóch szyn umożliwiających montaż sprzętu dodatkowego,
- Zamawiający wymaga aby wózek był wyposażony w nadstawkę z pojemnikami oraz wieszakiem na płyny infuzyjne a także maszt z możliwością montażu monitora, uchwyt umożliwiający bezpieczny montaż worka na odpady oraz pojemnika na zużyte igły, dopuszczając wyposażenie w nadstawkę z uchylnymi pojemnikami na leki i dodatkowy sprzęt oraz wieszakiem na płyny infuzyjne, a także półkę z możliwością podstawienia na niej monitora, z zastosowaniem pojemników na odpady i zużyte igły.
- Zamawiający wymaga aby fronty wózków były w paletce barw RAL a co za tym idzie odpowiednio dobrane kolorystycznie uchwyty.

3. Czy Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem wykonany był w całości ze stali lakierowanej proszkowo, z blatem i bandami zabezpieczającymi ze stali kwasoodpornej ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem wykonany był w całości ze stali lakierowanej proszkowo zastrzegając, iż zastosowane inne materiały muszą posiadać atesty pozwalające na zastosowanie przyjętych rozwiązań dla obiektów służby zdrowia w tym przy stosowaniu środków dezynfekujących materiałów. Blat i bandami zabezpieczającymi ze stali kwasoodpornej lub patrz odpowiedź na pytanie jak wyżej.

4. Czy Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem wykonany był w całości ze stali kwasoodpornej ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga by wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem wykonany był w całości ze stali kwasoodpornej. (Patrz odpowiedzi na pytania wyżej)

5. Czy Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem posiadał wymiary:
Długość : 600mm Szerokość : 500mm

Wysokość od podłoża do blatu : 1000mm

Wysokość całkowita wózka : 1300 – 1700mm ?

Wymiary podane powyżej są najbardziej optymalne w użytkowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem posiadał precyzyjnie wymienione powyżej wymiary. Zamawiający wymaga aby dostarczony wózek był zaprojektowany i wykonany zgodnie z zasadami ergonomii a co za tym idzie był przystosowany do użytkowania w obiektach służby zdrowia.

6. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający miał na myśli opisując : „uchylne pojemniki na leki i dodatkowy sprzęt „ ? Czy chodzi Zamawiającemu o pojemniki znajdujące się w nadstawce ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż chodzi o pojemniki znajdujące się w nadstawce.

7. Czy Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem posiadał 4 koła o średnicy 125 mm w tym 2 z hamulcem ? Umożliwia to dużą zwrotność wózka i łatwe prowadzenie sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza , iż wózek z dodatkowym wyposażeniem winien posiadać 4 koła w tym 2 z hamulcem , bez określania ich średnicy.

8. Czy Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem posiadał półkę nadblatową zamontowaną nad blatem wózka na stelażu umożliwiającym regulację wysokości półki ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wózek z dodatkowym wyposażeniem winien posiadać półkę nadblatową z rozwiązaniem umożliwiającym regulację jej wysokości.

9. Czy Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem posiadał dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek 54x35 mm, z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt ? Takie mocowanie nie odkształca się podczas użytkowania oraz nie dopuszcza do przesuwania się osprzętu podczas jazdy. Dodatkowym atytem tego typu mocowania jest fakt, że osprzęt można także zamontować na szynie Modur o przekroju 10x30mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem posiadał dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek 54x35 mm, z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt.

10. Czy Zamawiający wymaga wózka Medycznego o wymiarach bez akcesoriów (dł x szer. x wys.) 690x700x985 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby dostarczony wózek był zaprojektowany i wykonany zgodnie z zasadami ergonomii a co za tym idzie był przystosowany do użytkowania w obiektach służby zdrowia.

11. Czy Zamawiający może zrezygnować z uchylnych pojemników na leki i dodatkowy sprzęt, skoro wózek wyposażony jest w nadstawkę z pojemnikami z tworzywa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z uchylnych pojemników na leki i dodatkowy sprzęt.

Pytania do Pakietu nr 2

Wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem 4 szt

1. Dotyczy: Pakiet nr 2 – Wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem – 4 szt : Prosimy o wyrażenie zgody na realizację zamówienia w terminie do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Dotyczy: Pakiet nr 2 – Wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem – 4 szt : Czy Zamawiający dopuści **wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem** o poniższych parametrach?

- Błat roboczy z bandą ograniczającą z trzech stron wykonaną z wysokiej jakości tworzywa ABS.
- Wózek wyposażony w minimum dwie szuflady z półką podbłatową wysuwaną.
- Wyposażony w blat górny posiadający wyprofilowane brzożki służące jako uchwyty do prowadzenia wózka.
- Wyposażenie dodatkowe:
 - uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły
 - jedna szyna umożliwiająca montaż sprzętu dodatkowego
 - wyposażony w nadstawkę z uchylnymi pojemnikami na leki i dodatkowy sprzęt oraz wieszakiem na płyny infuzyjne, a także półkę z możliwością podstawienia na niej monitora
 - pojemnik na odpady
- Możliwość wyboru koloru uchwytów do szuflad (do wyboru kolor czerwony, żółty, pomarańczowy, niebieski, granatowy, zielony)

Odpowiedź:

- **Zamawiający dopuszcza zastosowanie blatu roboczego z bandą ograniczającą z trzech stron wykonaną z wysokiej jakości tworzywa ABS warunkując dopuszczenie dostarczeniem odpowiednich atestów pozwalających na zastosowanie rozwiązania w obiektach służby zdrowia w tym przy stosowaniu środków dezynfekujących.,**

- Wózek wyposażony w minimum pięć szuflad z półką nadblatową zgodnie z opisem zamówienia'
 - Zamawiający dopuszcza blat górny posiadający wyprofilowane brzeży służące jako uchwyty do prowadzenia wózka,
 - Zamawiający wymaga zastosowania minimum dwóch szyn umożliwiających montaż sprzętu dodatkowego,
 - Zamawiający wymaga aby wózek był wyposażony w nadstawkę z pojemnikami oraz wieszakiem na płyny infuzyjne a także maszt z możliwością montażu monitora, uchwyt umożliwiający bezpieczny montaż worka na odpady oraz pojemnika na zużyte igły, dopuszczając wyposażenie w nadstawkę z uchylnymi pojemnikami na leki i dodatkowy sprzęt oraz wieszakiem na płyny infuzyjne, a także półkę z możliwością podstawienia na niej monitora, z zastosowaniem pojemników na odpady i zużyte igły.
 - Zamawiający wymaga aby fronty wózków były w palecie barw RAL a co za tym idzie odpowiednio dobrane kolorystycznie uchwyty.
3. Czy Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem wykonany był w całości ze stali lakierowanej proszkowo, z blatem i bandami zabezpieczającymi ze stali kwasoodpornej ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem wykonany był w całości ze stali lakierowanej proszkowo zastrzegając, iż zastosowane inne materiały muszą posiadać atesty pozwalające na zastosowanie przyjętych rozwiązań dla obiektów służby zdrowia w tym przy stosowaniu środków dezynfekujących materiału. Blat i bandami zabezpieczającymi ze stali kwasoodpornej lub patrz odpowiedź na pytanie jak wyżej.

4. Czy Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem wykonany był w całości ze stali kwasoodpornej ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem wykonany był w całości ze stali lakierowanej proszkowo zastrzegając, iż zastosowane inne materiały muszą posiadać atesty pozwalające na zastosowanie przyjętych rozwiązań dla obiektów służby zdrowia w tym przy stosowaniu środków dezynfekujących materiału. Blat i bandami zabezpieczającymi ze stali kwasoodpornej lub zastosowanie blatu roboczego z bandą ograniczającą z trzech stron wykonaną z wysokiej jakości tworzywa ABS warunkując dopuszczenie dostarczeniem odpowiednich atestów pozwalających na zastosowanie rozwiązania w obiektach służby zdrowia w tym przy stosowaniu środków dezynfekujących.

5. Czy Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem posiadał wymiary :
- Długość : 735mm
- Szerokość : 620mm

Wysokość od podłoża do blatu : 1000mm

Wysokość całkowita wózka : 1700mm

Wymiary szafki : 600x 500mm

Wymiary półki : 600x500mm ?

Wymiary podane powyżej są najbardziej optymalne w użytkowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem posiadał precyzyjnie wymienione powyżej wymiary. Zamawiający wymaga aby dostarczony wózek był zaprojektowany i wykonany zgodnie z zasadami ergonomii a co za tym idzie był przystosowany do użytkowania w obiektach służby zdrowia.

6. Czy Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem posiadał półkę podblatową, która znajduje się po prawej lub lewej stronie wózka ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem posiadał wysuwaną półkę podblatową bez określania jej strony lokalizacji.

7. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający miał na myśli opisując : „uchylne pojemniki na leki i dodatkowy sprzęt „ ?Czy chodzi Zamawiającemu o pojemniki znajdujące się w nadstawce ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż chodzi o pojemniki znajdujące się w nadstawce.

8. Czy Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem posiadał 4 koła o średnicy 100 mm w tym 2 z hamulcem ? Umożliwia to dużą zwrotność wózka i łatwe prowadzenie sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza , iż wózek z dodatkowym wyposażeniem winien posiadać 4 koła w tym 2 z hamulcem , bez określania ich średnicy.

9. Czy Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem posiadał pod szufladami półkę z tworzywa ABS'u oraz podstawę stalową z osłoną z tworzywa ABS'u ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa wymagań co do zastosowanego materiału i przyjętych rozwiązań.

10. Czy Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem wykonany był ze stelaża aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały, umożliwiającą dowolną regulację umieszczenia szafki z szufladami oraz półki ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących konstrukcji wózka medycznego z dodatkowym wyposażeniem zwracając uwagę, iż Zamawiający wymaga aby fronty wózków były w palecie barw RAL

11. Czy Zamawiający wymaga aby wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem posiadał profil nośny z kanałami montażowymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie , przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów ? Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wymowalną uszczelką zabezpieczającą dostawanie się i gromadzenie brudu i drobnoustrojów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących konstrukcji wózka medycznego z dodatkowym wyposażeniem, pozostawiając dowolność rozwiązań producentowi- dostawy zwracając uwagę, iż wózek winien być przystosowany do użytkowania w obiektach służby zdrowia.

12. Czy Zamawiający wymaga wózka Medycznego o wymiarach bez akcesoriów (dł x szer. x wys.) 690x700x985 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby dostarczony wózek był zaprojektowany i wykonany zgodnie z zasadami ergonomii a co za tym idzie był przystosowany do użytkowania w obiektach służby zdrowia.

13. Czy Zamawiający może zrezygnować z uchylnych pojemników na leki i dodatkowy sprzęt, skoro wózek wyposażony jest w nadstawkę z pojemnikami z tworzywa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z uchylnych pojemników na leki i dodatkowy sprzęt.


Pytanie do Pakietu nr 1 i 2

Zadanie nr 1 i 2 Wózek medyczny z dodatkowym wyposażeniem

1. Czy zamawiający dopuści do przetargu wózki medyczne o następujących parametrach:
 - wózek wykonany ze stali malowanej proszkowo
 - 5 szuflad (2 szuflady o wys. 76mm; 2 szuflada o wys. 155mm; 1 szuflada o wys. 234mm)
 - centralny zamek
 - pierwsza szuflada posiada dodatkowe zamknięcie np. na leki o działaniu narkotycznym
 - dwie szuflady (76mm oraz 155mm wyposażone w plastikowe przedziałki z możliwością dowolnej konfiguracji)
 - Wózek z możliwością wyjęcia wszystkich szuflad
 - blat roboczy wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS ze wszystkich stron zagłębiony (burta z trzech stron)
 - uchwyt do prowadzenia

- wysuwany blat boczny
- zamykany kosz na odpady
- regulowany wieszak na płyny infuzyjne
- pojemniki do segregacji leków i akcesorii (nadstawka -17 kuwetek)
- stelaż do mocowania pojemników
- pojemnik na rękawiczki
- pojemnik na ostre elementy min. igły, strzykawki
- koła przeciwpółowe
- odboje na całej długości wózka
- wózek w kolorze niebieskim
- wózek na 4 kołach o średnicy 125 mm, z hamulcem na dwa koła i dodatkowym hamulcem kierunkowym
- wymiary wózka (szerokość x głębokość x wysokość do blatu) 690 x 518 x 1006 mm

Wizualizacja Wózka:

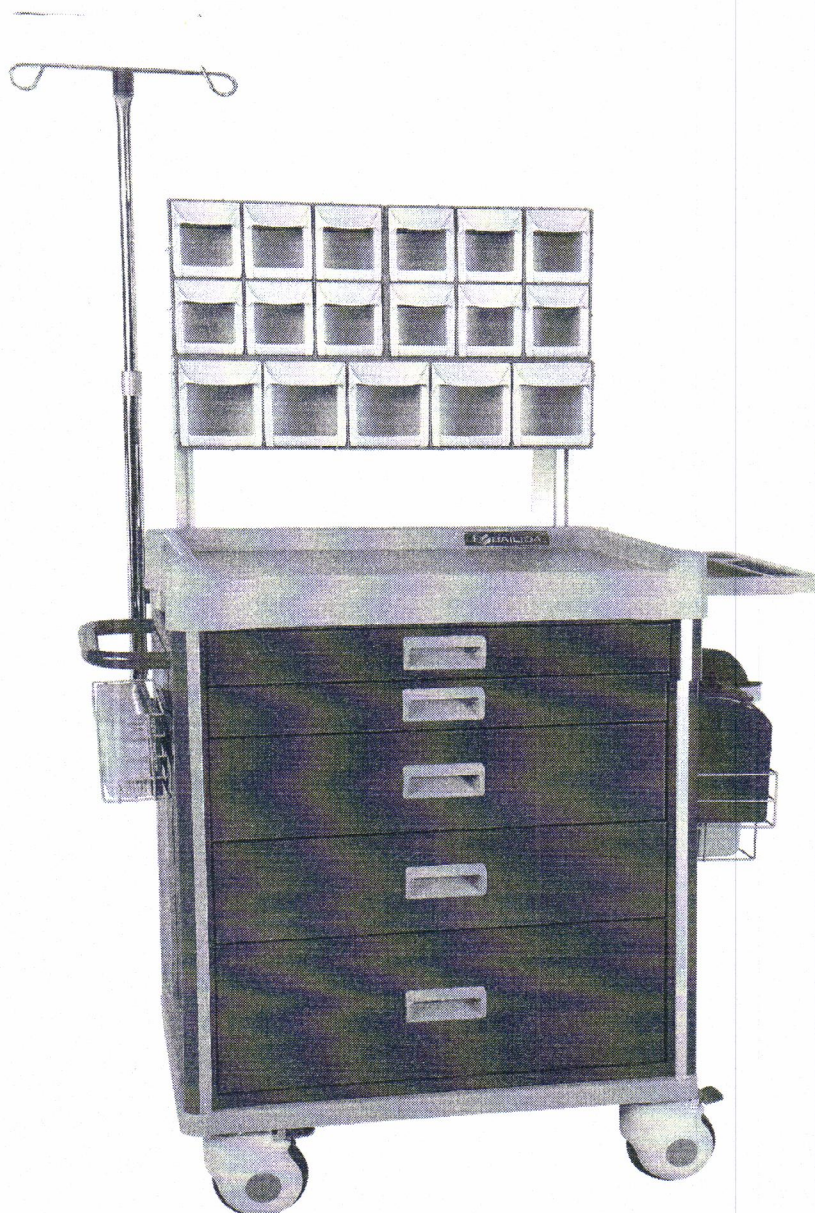

Odpowiedź:

Zamawiający w zamówieniu określił minimalne wymagania dotyczące wózków medycznych z dodatkowym wyposażeniem, dodatkowe zaproponowane wyposażenie nie dyskwalifikuje zaproponowanego modelu jeśli spełnia on podstawowe wymagania określone w specyfikacji.

Pytania do Pakietu nr 3

Stolik zabiegowy do pielęgnacji niemowląt - przewijak – szt. 8

1. Czy Zamawiający wymaga aby stół zabiegowy do pielęgnacji niemowląt – przewijak wykonany był w całości z płyty meblowej a fronty wykonane były z płyty MDF lakierowane wg palety RAL ? Takie wykonanie zapewnia estetykę oraz łatwe użytkowanie oraz dezynfekcję.

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dotyczące konstrukcji stolika zabiegowego do pielęgnacji niemowląt- przewijaka w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonanie ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo z frontami z płyty MDF lakierowanej wyposażony w zestaw minimum ośmiu szuflad z półkami oddzielającymi wyposażony w materac oraz półkę pod wagę wraz z wagą, koszem na odpady montowanym do stolika. Stół z możliwością poziomowania za pomocą regulacji wysokości stopek. Fronty w kolorze RAL

2. Czy Zamawiający wymaga aby stół zabiegowy do pielęgnacji niemowląt – przewijak wyposażony był w 8 szuflad, w 2 rzędach po 4 szuflady w każdym rzędzie , rozdzielone wolną przestrzenią z 1 półką, z możliwością regulacji wysokości umieszczenia półki oraz z 2 półkami z boku szafki ?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przyjęte rozwiązanie warunkując je zastosowaniem pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Czy Zamawiający wymaga aby stół zabiegowy do pielęgnacji niemowląt – przewijak posiadał wymiary :

Długość zewnętrzna stolika : 1400mm

Szerokość zewnętrzna stolika : 580mm

Wysokość stolika od podłoża do blatu : 900mm

Wymiary samej szafki :

Długość : 1100mm


Szerokość : 580mm ?

Wymiary podane powyżej są najbardziej optymalne w użytkowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby stół zabiegowy do pielęgnacji niemowląt – przewijak posiadał precyzyjnie wymienione powyżej wymiary. Zamawiający wymaga aby dostarczony wózek był zaprojektowany i wykonany zgodnie z zasadami ergonomii a co za tym idzie był przystosowany do użytkowania w obiektach służby zdrowia.

4. Czy Zamawiający wymaga aby stół zabiegowy do pielęgnacji niemowląt – przewijak wyposażony był w kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową w obudowie drucianej stalowej, umieszczony na boku stolika pod wydłużoną częścią blatu, nie powiększając gabarytu stolika swoją obecnością ?



Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dotyczące konstrukcji stolika zabiegowego do pielęgnacji niemowląt- przewijaka w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonanie ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo z frontami z płyty MDF lakierowanej wyposażony w zestaw minimum ośmiu szuflad z półkami oddzielającymi wyposażony w materac oraz półkę pod wagę wraz z wagą, koszem na odpady montowanym do stolika. Stół z możliwością poziomowania za pomocą regulacji wysokości stopek. Fronty w kolorze RAL. Zatem miejsce zamontowania, sposób i wykonanie kosza na odpady winne być dostosowane do warunków wynikających z ergonomii pracy.

5. Czy Zamawiający wymaga aby stół zabiegowy do pielęgnacji niemowląt – przewijak wyposażony był w wagę dwuzakresową do ważenia niemowląt do 10/20 kg z kołyską z tworzywa sztucznego (polistyrenu), który łatwy jest do dezynfekcji i demontażu. Waga wyposażona w zasilanie sieciowe oraz baterie 230AC/11V AC, oraz wyświetlacz LCD i złącze RS 232 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytania do Pakietu nr 4

Przewijak z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym) - szt. 1

1. Czy Zamawiający wymaga aby Przewijak z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym) , posiadał stelaż stalowy lakierowany proszkowo ? Dzięki stelażowi stalowemu stół jest bardziej stabilny.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia Przewijak z promiennikiem- niski (ogrzewaczem noworodkowym) jako: Stolik wysokości do 90 cm, o konstrukcji stalowej zabezpieczonej wymalowaniem- lakierowanym proszkowo, blat stolika stalowy zabezpieczony jak wyżej z wyposażony w materac tapicerowany, blat wyposażony w bandy z trzech stron. Przewijak wyposażony w szafkę zamykaną drzwiczkami oraz minimum trzy szuflady oraz szufladę do ustawienia wagi, przewijak wyposażać w promiennik. Fronty w kolorze RAL

2. Czy Zamawiający wymaga aby Przewijak z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym), posiadał blat stalowy lakierowany proszkowo, wyposażony w tapicerowany materacyk i otoczony z 3 stron materiałem tapicerowanym? Takie wykonanie jest bardziej funkcjonalne oraz odpowiednia zabezpiecza noworodka leżącego na stoliku.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia Przewijak z promiennikiem- niski (ogrzewaczem noworodkowym) jako: Stolik wysokości do 90 cm, o konstrukcji stalowej zabezpieczonej wymalowaniem- lakierowanym proszkowo, blat stolika stalowy zabezpieczony jak wyżej z wyposażony w materac tapicerowany, blat wyposażony w bandy z trzech stron. Przewijak wyposażony w szafkę zamykaną drzwiczkami oraz minimum trzy szuflady oraz szufladę do ustawienia wagi, przewijak wyposażać w promiennik. Fronty w kolorze RAL

3. Czy Zamawiający wymaga aby szafka Przewijaka z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym), wykonana była z płyty meblowej laminowanej białej wraz z frontami szuflad i drzwiczkami – kolor do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia Przewijak z promiennikiem- niski (ogrzewaczem noworodkowym) jako: Stolik wysokości do 90 cm, o konstrukcji stalowej zabezpieczonej wymalowaniem- lakierowanym proszkowo, blat stolika stalowy zabezpieczony jak wyżej z wyposażony w materac tapicerowany, blat wyposażony w bandy z trzech stron. Przewijak wyposażony w szafkę zamykaną drzwiczkami oraz minimum trzy szuflady oraz szufladę do ustawienia wagi, przewijak wyposażać w promiennik. Fronty w kolorze RAL

4. Czy Zamawiający wymaga aby Przewijak z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym), wyposażony był w koła z tworzywa sztucznego o średnicy 75mm, w tym 2 z blokadą? Umożliwia to dużą zwrotność stolika i łatwe prowadzenie sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takich wymagań

5. Czy Zamawiający wymaga aby Przewijak z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym), posiadał wymiary:

Długość stolika: 900mm

Szerokość stolika : 700mm

Wysokość od podłoża do blatu : 870mm

Wysokość całkowita stolika : 900mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby stolik zabiegowy do pielęgnacji niemowląt – przewijak posiadał precyzyjnie wymienione powyżej wymiary. Zamawiający wymaga aby dostarczony stolik był zaprojektowany i wykonany zgodnie z zasadami ergonomii a co za tym idzie był przystosowany do użytkowania w obiektach służby zdrowia.

6. Czy Zamawiający wymaga aby Przewijak z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym) , wyposażony był w ogrzewacz noworodkowy na stelażu montowany do tylnej części stolika ? Takie rozwiązanie jest bezpieczne w użytkowaniu zarówno dla personelu pielęgniarstwa jak i noworodków.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

7. Czy Zamawiający wymaga aby Przewijak z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym) , wyposażony był w ogrzewacz noworodkowy wyposażony w układ automatycznej regulacji temperatury powietrza, oraz w system alarmowy ? Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania zarówno dla personelu pielęgniarstwa jak i noworodków.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytania do Pakietu nr 5

Przewijak z promiennikiem wysoki (ogrzewaczem noworodkowym) - szt. 1

1. Czy Zamawiający wymaga aby Przewijak z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym) , posiadał stelaż stalowy lakierowany proszkowo ? Dzięki stelażowi stalowemu stolik jest bardziej stabilny.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest Przewijak z promiennikiem- wysoki (ogrzewaczem noworodkowym) -Stolik na podstawie jezdnej z blatem roboczym lakierowanym proszkowo z blatem zabezpieczonym bandami z minimum trzech stron, wyposażony w tapicerowany materac, minimum dwie szuflady w wysuwanej półkę pod wagą, dopuszcza się zastosowanie do tego celu górną szufladę, Przewijak wyposażyc w promiennik. Wysokość stolika 110 cm. Fronty w kolorze RAL

2. Czy Zamawiający wymaga aby Przewijak z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym) , posiadał blat stalowy lakierowany proszkowo, wyposażony w tapicerowany materacyk i otoczony z 3

stron materiałem tapicerowanym ? Takie wykonanie jest bardziej funkcjonalne oraz odpowiednia zabezpiecza noworodka leżącego na stoliku.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest Przewijak z promiennikiem- wysoki (ogrzewaczem noworodkowym) -Stolik na podstawie jezdnej z blatem roboczym lakierowanym proszkowo z blatem zabezpieczonym bandami z minimum trzech stron, wyposażony w tapicerowany materac, minimum dwie szuflady w wysuwana półkę pod wagą, dopuszcza się zastosowanie do tego celu górną szufladę, Przewijak wyposażyc w promiennik. Wysokość stolika 110 cm. Fronty w kolorze RAL

3. Czy Zamawiający wymaga aby szafka Przewijaka z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym) ,wykonana była z płyty meblowej laminowanej białej a także fronty szuflad wykonane były z płyty meblowej laminowanej – kolor do wyboru przez Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Zamawiający określił przedmiotem zamówienia jako Przewijak z promiennikiem- wysoki (ogrzewaczem noworodkowym) -Stolik na podstawie jezdnej z blatem roboczym lakierowanym proszkowo z blatem zabezpieczonym bandami z minimum trzech stron, wyposażony w tapicerowany materac, minimum dwie szuflady w wysuwana półkę pod wagą, dopuszcza się zastosowanie do tego celu górną szufladę, Przewijak wyposażyc w promiennik. Wysokość stolika 110 cm. Fronty w kolorze RAL

4. Czy Zamawiający wymaga aby Przewijak z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym) , wyposażony był w koła z tworzywa sztucznego o średnicy 75mm, w tym 2 z blokadą ? Umożliwia to dużą zwrotność stolika i łatwe prowadzenie sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza , iż stolik na podstawie jezdnej winien posiadać 4 koła w tym 2 z hamulcem - blokadą bez określania ich średnicy.

5. Czy Zamawiający wymaga aby Przewijak z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym) , posiadał wymiary :

Długość stolika : 900mm

Szerokość stolika : 700mm

Wysokość od podłoża do blatu : 1070mm

Wysokość całkowita stolika : 1100mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby stolik zabiegowy do pielęgnacji niemowląt – przewijak posiadał precyzyjnie wymienione powyżej wymiary. Zamawiający wymaga aby dostarczony stolik był zaprojektowany i wykonany zgodnie z zasadami ergonomii a co za tym idzie był przystosowany do użytkowania w obiektach służby zdrowia.

6. Czy Zamawiający wymaga aby Przewijak z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym) , wyposażony był w ogrzewacz noworodkowy na stelażu montowany do tylnej części stolika ? Takie rozwiązanie jest bezpieczne w użytkowaniu zarówno dla personelu pielęgniarstwa jak i noworodków.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

7. Czy Zamawiający wymaga aby Przewijak z promiennikiem niski (ogrzewaczem noworodkowym) , wyposażony był w ogrzewacz noworodkowy wyposażony w układ automatycznej regulacji temperatury powietrza oraz w system alarmowy ? Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania zarówno dla personelu pielęgniarstwa jak i noworodków.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytania do Pakietu nr 6

Lampa zabiegowa – medyczna na kółkach

1. Czy Zamawiający oczekuje aby lampa emitowała natężenie na poziomie co najmniej 40 000 lux z odległości pół metra?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający oczekuje aby lampa emitowała światło o temperaturze barwowej 4 400 K°? Temperatura taka jest najbardziej optymalna dla użytkowników i jest charakterystyczna dla wysokiej jakości lamp zabiegowych led.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytania do Pakietu nr 7

Lampa zabiegowa przypinana

1. Czy Zamawiający oczekuje aby lampa emitowała natężenie na poziomie co najmniej 40 000 lux z odległości pół metra?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający oczekuje aby lampa emitowała światło o temperaturze barwowej 4 400 K°? Temperatura taka jest najbardziej optymalna dla użytkowników i jest charakterystyczna dla wysokiej jakości lamp zabiegowych led.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z włącznikiem dotykowym? Rozwiązanie takie jest bezpieczniejsze ponieważ chroni przed przypadkowym włączeniem/ wyłączeniem lampy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

UWAGA; Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

Krystyna Kulesza-Huryń
mgr Krystyna Kulesza-Huryń