

Białystok, dn. 21.06.2017r.

Numer pisma: DA-ZP-252-39-1/17

Wszyscy
zainteresowani Wykonawcy


Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożenia pola operacyjnego, bielizny operacyjnej i sprzętu jednorazowego użytku, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-39/17.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania i odpowiedzi

Pytania do Pakietu nr 1

1. **dotyczy Pakiet nr 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu dwuwarstwowego minimalnie odbiegającego wymiarami od opisanego, spełniającego parametry techniczne:
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
 - 1 taśma przyklepna 9 x 50 cm
 - 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
 - 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
 - 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torebką na płynie 72x72cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów
 - 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

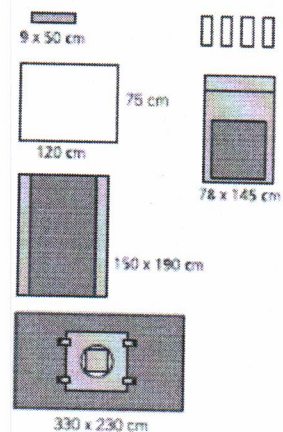

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch typu przedniak pakowany w opakowanie a'100 szt. Z wyceną za opakowanie I odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia nie występuje w Pakiecie nr 1.

3. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny, wykonany w włókniny, niesterylny, jednorazowy, wiązany na troki, rękaw wykończony mankietem, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia nie występuje w Pakiecie nr 1.

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu cięcia cesarskiego w którym serweta główna jest w kształcie litery T o min. wym. 250x315cm, z przyklepionym oknem o wymiarach 18 x 28 x 32 cm wypełnionym w 100% folią chirurgiczną, otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2 zaworkami spustowymi, serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarze 140cm x 190cm, zestaw zawiera dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności, 2 ręczniki celulozowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. **Pakiet 1:** Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do cięcia cesarskiego w składzie:

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

b) 2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

d) 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

e) 1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej wypełniony folią chirurgiczną.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego. Otwór w serwecie głównej wypełniony folią chirurgiczną, ekran anestezyjologiczny wykonany z folii polietylenowej.

Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

LUB

Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do cięcia cesarskiego w składzie:

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

b) 4 ręczniki 30 cm x 40 cm

c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

d) 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny

e) 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z chłonnego i nieprzepuszczalnego trilaminatu (polietylen + polipropylen) ze wzmocnieniem chłonnym, serweta główna w kształcie litery T w rozmiarze w nogach 196 cm, przy głowie 249 x 300 cm, z otworem 30 x 36 cm częściowo wypełnioną folią operacyjną, z workiem na płyny 270°, serwety na stolik stolik narzędziowy 140 x 190 cm, na stolik Mayo 80 x 142 cm w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. **poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- wykonany z włókniny o gramaturze 43 g/m²

- pozbawiony serwety 150cm x 190cm

- w którym serweta o wymiarach co najmniej 325cm x 250cm ma otwór o rozmiarze 35cm x 32cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, Pozycja 1 zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- Serweta o wymiarach co najmniej 325 x 250 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z otworem o wymiarach 25 x 30 cm (zamiast 35 x 35 cm) wypełnionym folią chirurgiczną, z workiem na płynie – 1 szt
- Podkładka dla noworodka – 1 szt
- Serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm – 1 szt
- Obłożenie stolika Mayo 80 x 140 cm (zamiast 80 x 145 cm) – 1 szt
- Ręczniki włókninowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 2

1. **Pakiet 2, pozycja 1** - Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do porodu zawierający:

- serweta 120 cm x 90 cm - 1 szt.,
 - serweta 120 cm x 90 cm – 1 szt.,
- obie w/w serwety wykonane z włókniny o gramaturze 56g/m² wykonane z włókniny, z jednej strony posiadający folię polietylenową, zabezpieczającą przez przesiąkaniem, z drugiej strony chłonną włókniną polipropylenową;
- serwetka z włókniny kompresowej o gramaturze 75 g/m², 80 cm x 75 cm – 1 szt.;
 - podkład higieniczny 90 cm x 60 cm wykonany z pulpy celulozowej, pokryty folią antypoślizgowa, Chłonność 0,152 ml/cm² – 1 szt,
 - podkład higieniczny 90 cm x 60 cm wykonany z pulpy celulozowej pokryty folią antypoślizgowa, Chłonność 0,152 ml/cm² – 1 szt,
 - serwetka z włókniny kompresowej 30 cm x 30 cm - 6 szt.

Zestaw zapakowany w torbę foliowo-papierową. Na opakowaniu 4 samoprzylepnymi naklejki (metki) z informacjami: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. **Pakiet 2, pozycja 2** - Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw dla noworodka w składzie zgodnym z SIWZ gdzie ściereczki będą miały gramaturę 55 g/m² ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.


3.poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta 120cm x 90cm ma wymiar 130cm x 90cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 3

1. **dotyczy Pakiet nr 3 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do biodra w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta 100 x 150cm 2-warstwowa na całej powierzchni
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm wykonana z kratonu
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

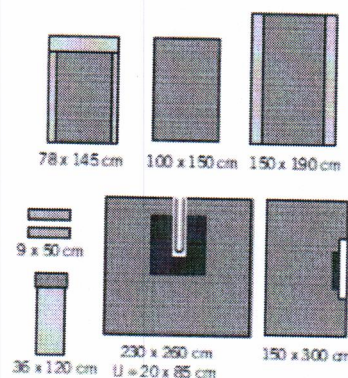

Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy o gramaturze 60 g/m² w części podstawowej + łatę chłonną o gramaturze 80 g/m².

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


2. dotyczy Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji na kończynie w składzie powiększonym, tj.:


1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm

- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 1 taśma mocująca 9x50cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, z warstwą chłonną 75 x 80 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Odpowiedź: Dopuszczamy.

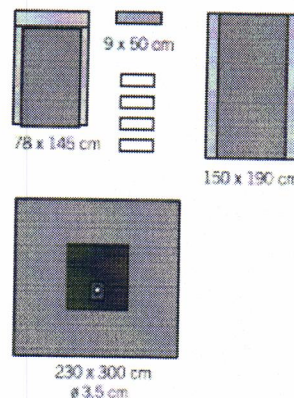

- 3. PAKIET NR 3 Pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożenia biodra, spełniającego wymogi SIWZ, wykonanego z dwuwarstwowego laminatu (włóknina – folia) o gramaturze 55 g/m², obszary wzmocnione o gramaturze 110 g/m² w następującym składzie:

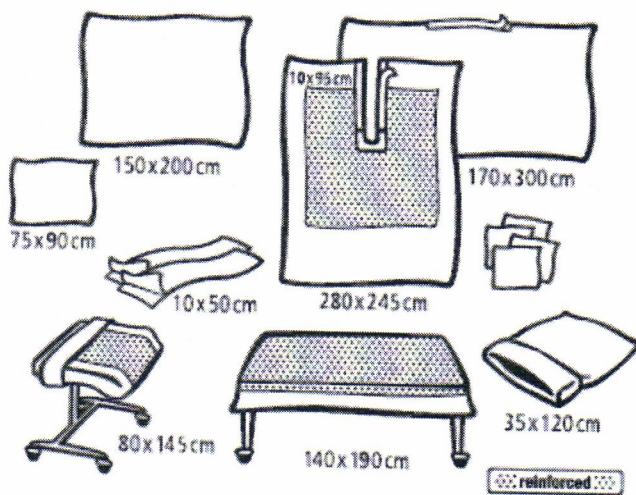

Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra II wzmocniony

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna	170 x 300
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym (10 x 95 cm)	245 x 280
1 serweta nieprzylepna	150 x 200
1 serweta nieprzylepna	75 x 90
1 osłona na kończynę	35 x 120
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33


Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione

Opakowanie z zestawem obłożenia bez oznakowania piktogramem miejsca otwierania. Szeroki margines umożliwia intuicyjne rozpakowanie zestawu.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji na kończynie bez osłony na stolik Mayo w swoim składzie:

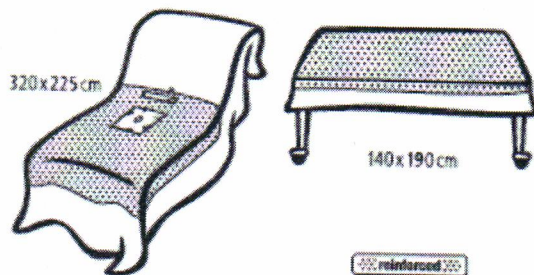

Zestaw do zabiegów na kończynie
wzmocniony

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm)	320 x 225
Opakowanie dodatkowe - papier krepowy	

Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Lub

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ww. zestawu wraz z niezależnie pakowaną osłoną na stolik Mayo, załączoną do ww. zestawu ?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
5. Pakiet nr 3 poz.1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do chirurgii biodra wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m², zestaw zawiera dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności, pozostałe parametry zgodne?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
6. Pakiet nr 3 poz.2: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do operacji na kończynie, wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Skład : 1 serweta główna wzmocniona w kształcie "T" o minimalnych wymiarach 270x320cm z samouszczelniającym się otworem i uchwytem na dreny i przewody, 1 serweta o wymiarach min. 100x150cm; 1 samoprzylepna taśma mocująca ("rzep") 2,5x25cm. Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw posiada dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
7. **Pakiet 3, pozycja 1** - Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do biodra zgodny z SIWZ gdzie osłona ortopedyczna na kończynę będzie wykonana z elastycznego neoprenu o wymiarach 30 x 120 cm ?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
8. **Pakiet 3, pozycja 2** - Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji na kończynie zgodny z SIWZ gdzie serweta główna z otworem i elementami elastycznymi będzie miała wymiary 200 x 300 cm ?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

9. **Pakiet 3 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw obłożenia do biodra o składzie:
- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - b) 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - c) 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm
 - d) 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
 - e) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
 - f) 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
 - g) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
 - h) 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
 - i) 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych
 - j) 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

10. **Pakiet 3 poz. 2:** Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów na kończynie o składzie:
- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
 - d) 1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

11. **poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta 150cm x 150-200 cm ma wymiar 150cm x 90cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

12. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczanie w Pakiecie nr 3, pozycji 1 serwety na stolik Mayo o rozmiarze 80 x 140 cm (zamiast 80 x 145 cm). Pozostałe parametry w granicach wyznaczonych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 4

1. **Pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego spełniającego wymogi SIWZ, wykonanego z włókniny typu SMMMS, posiadającego nadruk o jego rozmiarze, z kolorową lamówką informującą o rodzaju fartucha (standard, wzmocniony) zamiast rozmiarze fartucha, fartuch owinięty w serwetę włókninową, opakowanie zawiera również ręczniki celulozowe ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. **Pozycja 2:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wzmocnionego spełniającego wymogi SIWZ, wykonanego z włókniny typu SMMMS, posiadającego nadruk o jego rozmiarze, z kolorową lamówką informującą o rodzaju fartucha (standard, wzmocniony) zamiast rozmiarze fartucha, fartuch owinięty w serwetę włókninową, opakowanie zawiera również ręczniki celulozowe ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania fartuchy jałowe wykonane z włókniny SMMMS o gramaturze min. 35g/m². Fartuch wyraźnie oznaczony rozmiar na opakowaniu jednostkowym oraz rozmiar naniesiony bezpośrednio na fartuchu. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania fartuchy jałowe wykonane z włókniny SMMMS o gramaturze min. 35g/m², części wzmocnione trwale przymocowane do fartucha o gramaturze min. 40g/m². Fartuch wyraźnie oznaczony rozmiar na opakowaniu jednostkowym oraz rozmiar naniesiony bezpośrednio na fartuchu. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, pozycja 1 jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3, wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMS/SMMS o gramaturze min. 45 g/m² i nieprzemakalności min. 30 cm H₂O wytrzymałość na wypychanie min. 196 kPa, rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z producentami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Rozmiar M, L, XL, XXL?


Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 4, Pozycja 2 Fartuch chirurgiczny wzmocniony – jednorazowego użytku, do zabiegów standardowego i/lub wysokiego ryzyka (fartuch wysokiego ryzyka do długich zabiegów, operacyjnych wykonany z wysoko przewiewnej hydrofobowej włókniny typu SMS/SMMS) sterylny dobrze oddychający, z wstawkami nieprzemakalnymi z laminatu z wewnętrzną warstwą chłonną w części krytycznej – przód i rękawy powyżej łokcia. Rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny, dobrze utrzymującymi się podczas użytkowania. Tylne połacie zakładane i wiązane na troki łączące kartonikami, sposób złożenia pozwalający na aplikację z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu. Przy szyi zapięcie na rzep. Fartuch spełniał następujące minimalne wymagania: 1) włóknina o gramaturze ≥ 73 g/m² w obszarze krytycznym i poza obszarem krytycznym 45 g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym ≥ 144 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho i mokro min. 160 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 116 N, na mokro min. 115N. Pozostałe parametry w granicach normy PN-EN 13795. 2) Opakowanie: papier-folia zewnętrzna zgrzewana, dwie etykiety w języku polskim zawierająca numer katalogowy, serię, datę ważności, oznaczenie producenta. Rozmiar M, L, XL, XXL?


Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 5

1. **Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania sterylnego obłożenia do PCNL spełniającego wymogi SIWZ, wykonanego z dwuwarstwowego laminatu (włóknina – folia) o gramaturze 55 g/m² w następującym składzie:



150 x 200 cm

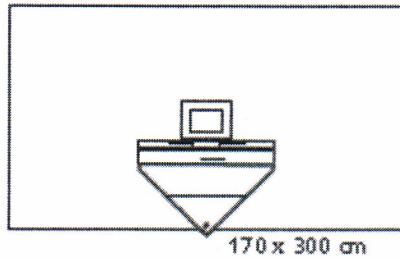

170 x 300 cm

Zestaw do PCNL

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy	150 x 200
1 serweta z otworem samoprzylepnym bez folii operacyjnej (15x20cm) i workiem do zbiórki płynów	170 x 300

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Pakiet nr 5 poz.1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych TUR, w którym serweta główna o minimalnych wymiarach 185x260cm posiada: zintegrowane nogawice, worek do zbierania płynów z sitem i zaworkiem spustowym, przylepne okno nadłonowe oraz przylepne okno do obłożenia okolic krocza i bezlateksową osłonę na palec, dren o długości 150cm i średnicy min. 1,5cm. Zestaw posiada dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Pakiet nr 5 poz.2: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do PCNL serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 56 g/m². Skład: 1 serweta do PCNL 200x300cm z otworem samoprzylepnym 20x23 cm i workiem do zbierania płynów 60x120cm, serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw posiada dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, pozycji 1 Obłożenie operacyjne do zabiegów urologicznych TUR dopuści dren o długości min. 120 cm i min. średnicy 8 mm (zamiast 120 cm i średnicy 1,5 cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, pozycja 2 Sterylne obłożenie do PCNL wykonane z dwuwarstwowej, wodoszczelnej, pełnobarierowej włókniny (chłonnego i mocnego, dwuwarstwowego laminatu) o gramaturze min. 61/m² (zamiast 60,5 g/m²). Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 6

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 6 poz.2 fartucha w rozmiarze L/XL?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz.6 z pakietu nr 6 do osobnego zadania co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji 6 z Pakietu nr 6.

3. **dotyczy Pakiet nr 6 poz. 2 :** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym: 120x145cm spełniającego pozostałe wymagania stawiane w SIWZ.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
4. **Pakiet 6 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści fartuch wyłącznie w rozmiarach L i XL?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
5. **Pozycja 2:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch higieniczny w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
6. **Pakiet 6, pozycja 2 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów w rozmiarach L i XL?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
7. **Pakiet 6 poz. 2:** Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu i dopuszczenie w niej fartucha higienicznego w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 6.
8. **Pakiet 6, pozycja 2:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym (dł. Minimum 114cm) i rozmiarze XL (długość minimum 127cm).
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
9. **Pakiet 6, pozycja 2:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy należy zaoferować fartuch o gramaturze min. 20g/m²?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 7

1. **Pakiet 7, pozycja 1:** Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 7 pozycji 1 i utworzenie odrębnego pakietu co pozwoli zwiększyć konkurencyjność.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 7.
2. **Pakiet 7, pozycja 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty w rozmiarze 41 x 51cm?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 8

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 8 pokrycia z perforacją co 37cm?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 8 pokrycia z chłonnej włókniny wiskozowej (28g/m²) pokrytej folią (20g/m²) i warstwą celulozy?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 8 pokrycia z nawojem 50m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

4. **pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne, wykonane z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

5. **pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne z rolkami z perforacją co 38cm o szerokości 58cm i długości 50mb z przeliczeniem zamówionej ilości spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pokrycie higieniczne na rolce, wykonane z warstwy bibuły i folii o szerokości 50cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy

7. **Pakiet 8, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rolki o szerokości 50cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

8. **Pakiet 8 poz. 1** : Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne o szerokości rolki 51cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 9

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ramach pakietu nr 9 poz.1 koszuli z rozcięciem Y wiązany na troki?

Odpowiedź: Dopuszczamy. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 9 poz.1 koszuli nie zakładanej przez głowę lecz od przodu i wiązanej z tyłu na troki?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 9 poz.1 koszuli w rozmiarach M – XL lub M – XXL?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 9 poz.1 koszuli o długości min.110cm?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 9 poz.2 koszuli w rozmiarach M – XL lub M – XXL?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 9 poz.2 koszuli o długości min.110cm?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 9 poz.1 i 2 co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji 1 i 2 z Pakietu nr 9.
8. **Pakiet 9, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli o długości min. 111 cm w rozmiarach S, M, L, XL i XXL?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
9. **Pakiet 9, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli o długości min. 112,5cm w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
10. **Pakiet 9, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrań w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
11. **Pakiet 9, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sukienki w rozmiarach S, M, L, XL, XXL?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
- 12. Pakiet 9 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarach S/M, L/XL?
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
- 13. Pakiet 9 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści koszulę pozbawioną rozmiaru XXXL?
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
- 14. Pakiet 9 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze niebieskim i fioletowym?
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
- 15. Pakiet 9 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści ubranie pozbawione rozmiaru XXXL?
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
- 16. Pakiet 9 poz. 4 :** Czy Zamawiający dopuści sukienkę w rozmiarze uniwersalnym? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
-

Pytania do Pakietu nr 10

1. **Pakiet 10, pozycja 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na przewody w rozmiarze 15 x 240 cm, w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
-

Pytania do Pakietu nr 11

1. **dotyczy Pakiet nr 11** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy 9x50cm?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
2. Zamawiający w Pakiecie nr 11 złożył zamówienie na taśmy do mocowania serwet, sterylne, do zastosowania z obciążeniami wielorazowymi, W ofercie posiadamy niesterylne, wodorozpuszczalne włókninowe taśmy lepne o wymaganym w SIWZ wymiarze. Taśmy łatwo się mocuje do serwet, są spieralne i podlegają sterylizacji w temp. 134°C. **Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 dopuści włókninowe niesterylne taśmy wodorozpuszczalne o wym. 10x50cm z możliwością sterylizacji w temp. 134°C? Taśmy są zgodne z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC, posiadają Deklarację Zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.**
Odpowiedź: Dopuszczamy.
3. **Pakiet 11 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści taśmę o rozmiarze 9x50 cm?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
4. **Pakiet 11 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści taśmę o rozmiarze 9cm x 50cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
-

Pytania do Pakietu nr 12

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 12 poz.1 kompletu pościeli wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m²?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 12 poz.1 kompletu pościeli z poszwą o wymiarowaniu 160x200cm?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 12 poz.1 kompletu pościeli z poszwą o wymiarowaniu 150x200cm?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 12 poz.2 poszwy o wymiarowaniu 160x200cm?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 12 poz.2 poszwy o wymiarowaniu 150x200cm?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

6. **Pakietu nr 12 poz. Nr 6** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 12 poz. Nr 6 do odrębnego pakietu bądź dopuszczenie jednorazowego koca do okrycia pacjenta o wymiarze 110 x 220 cm z dwóch warstw włókniny polipropylenowej 30g/m² z wypełnieniem Molton 60 g/m², kolor niebiesko – zielony, pakownie indywidualne w zbiorczym opakowaniu 25 sztuk.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji nr 6 z Pakietu nr 12. Dopuszczamy, koc do okrycia pacjenta o wymiarze 110 x 220 cm z dwóch warstw włókniny polipropylenowej 30g/m² z wypełnieniem Molton 60 g/m², kolor niebiesko – zielony, pakownie indywidualne w zbiorczym opakowaniu 25 sztuk, przy czym zaoferowany wyrób ma spełniać pozostałe parametry określone w SIWZ.

7. **Pakiet 12 poz. 3,5:** Czy Zamawiający wymaga prześcieradeł składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka pakowane po 10 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

8. **Pakiet 12, pozycja 2, 4** – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie poszewek o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

9. **Pakiet 12, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie poszewki w rozmiarze 60 x 80cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 13

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 13 poz.3 czepka z chłonnej włókniny wiskozowej lub wiskozowej perforowanej o gramaturze min.25g/m²?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 13 poz.3 czepka – wysokość części przedniej 23cm, wymiary denka 15x26cm, troki długości min.20-22,5cm?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 13 poz.4 czepka z włókniny polipropylenowej min.14g/m²?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 13 poz.5 czepka z chłonnej włókniny wiskozowej lub wiskozowej perforowanej o gramaturze min.25g/m²?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 13 poz.6 czepka – wysokość części przedniej 23cm, wymiary denka 15x26cm?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 13 poz.6 czepka dostępnego w kolorach: zielonym, niebieskim, różowym?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz.1 i 2 z pakietu nr 13 do osobnego zadania co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji 1 i 2 z Pakietu nr 13.

8. **pozycja 1, 2** - Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji 1,2 z Pakietu nr 13.

9. **pozycja 1** - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje maski o skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie co najmniej 99,99%?

Odpowiedź: BFE min. 98 %.

10. **pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne pakowane po 25 sztuk spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 16

1. **Pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (włóknina – folia) o gramaturze 55 g/m² w rozmiarze 75 cm x 90 cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. **Pozycja 2:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (włóknina – folia) o gramaturze 55 g/m² w rozmiarze 50 cm x 90 cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. **Pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego w następującym składzie:


Skład zestawu:*

- 1 x kleszcze plastikowe 14 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 8 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
- 5 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

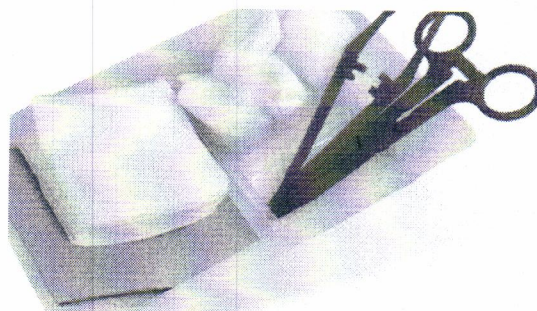

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. **Pozycja 4:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do usunięcia szwów w następującym składzie:


Skład zestawu:*

- 3 x tampony (tufery) włókninowe wielkości śliwki
- 1 x pęseta anatomiczna metalowa 12 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)

Opakowanie:

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

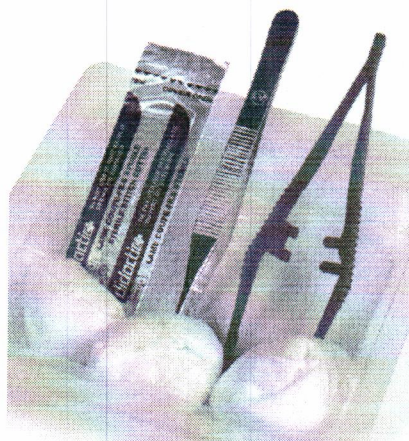

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. **Pozycja 5:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dezynfekcji w następującym składzie:


Skład zestawu:*

- 6 x tampony włókninowe (tufery) w kształcie kuli wielkości iaika
- 1 x kleszcze plastikowe 14 cm

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki


* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

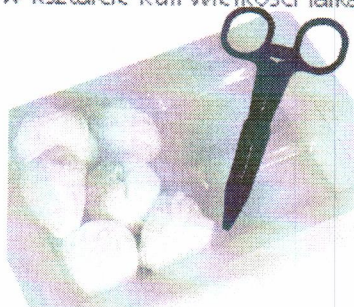

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. **Pozycja 6:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na przewody w rozmiarze 14 cm x 250 cm z taśmą samoprzylepną oraz teksturą ułatwiającą założenie ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

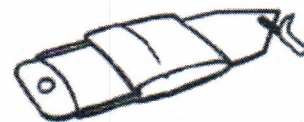

7. **Pozycja 7:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła spełniającego wymogi SIWZ zaklasyfikowanego jako wyrób higieniczny ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. **Pakiet 16, pozycja 1,2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet dwuwarstwowych (włóknina + laminat) o gramaturze min. 35g/m²?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
9. **Pakiet 16, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 75 x 90cm?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
10. **Pakiet 16, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 x 45cm?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
11. **Pakiet 16, pozycja 3** - Czy zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy zgodny z SIWZ gdzie serweta foliowana będzie miała wymiary 50cm x 75cm z otworem o średnicy 7cm.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
12. Zestaw zapakowany będzie w opakowanie typu folia-papier + dodatkowy pojemnik?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
13. **Pakiet 16, pozycja 4** - Czy zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier + dodatkowy pojemnik?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
14. **Pakiet 16, pozycja 5** - Czy zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier + dodatkowy pojemnik?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
15. **Pakiet 16, pozycja 6** - Czy zamawiający dopuści osłonę na przewody o wymiarach 16 x 250 cm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


16. Pakiet 16 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym ilość tupferów 20cm x 20cm wynosi 5szt.? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.


Pytania do Pakietu nr 17

1. **Pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluzy chirurgicznej zaklasyfikowanej jako wyrób higieniczny w rozmiarze M, L, rękawy wykończone ściągaczem, kołnierz wykonany z włókniny w postaci stójki, pozostałe parametry spełnione ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

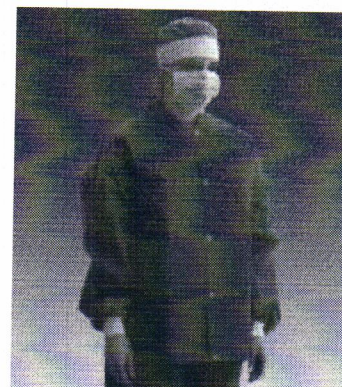

2. **Pozycje 2, 3:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka do przechwytywania płynów spełniającego wymogi SIWZ ?

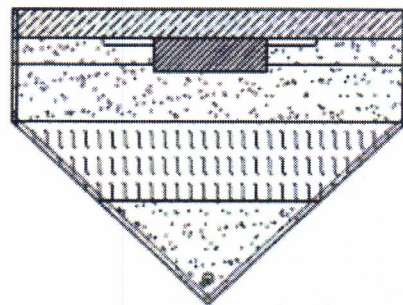

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 18

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z opisanym z serwetą na stół Mayo w rozmiarze 78x145cm oraz w poz. 2 serwetę również w rozmiarze 78x145cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. **Pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z dwuwarstwowego laminatu (włóknina – folia) o gramaturze 55 g/m² spełniającego wymogi SIWZ posiadającego w swoim składzie serwetę samoprzylepną w rozmiarze 200 x 175 cm zamiast 170-180 cm x 170-180 cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. **Pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw serwet uniwersalnych o następującym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm; warstwa chłonna 75x190cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm; warstwa chłonna 60x145 cm
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 150cm; warstwa chłonna 180x150 cm
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm warstwa chłonna 150x240 cm
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 90cm; warstwa chłonna 75x90 cm (przyklepic na dłuższym boku o szerokości 6cm)
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
- 2 ręczniki 40 x 40

Zestaw wykonany z nieprzemakalnego laminatu polipropylenowo poliestrowego o gramaturze min. 62g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę na stół Mayo w rozmiarze 78x145cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Pakiet nr 18 poz.1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu uniwersalnego, (podstawowego) wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², zawierającego 4 ręczniki celulozowe o wymiarze 30x40cm. Zestaw posiada dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Dopuszczamy. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

6. **Pakiet 18, pozycja 1** - Czy zamawiający dopuści dwuwarstwowy, jałowy, jednorazowy zestaw uniwersalny, o gramaturze 70 g/m² wykonany z włókniny, z jednej strony posiadający folię polietylenową, zabezpieczającą przed przesiąknięciem, z drugiej strony chłonną włókninę polipropylenową, odporny na rozdzieranie, zawierający minimum:

- serwetę 230cm x 150cm z przylepcem-1 szt,
- serwetę 150cm x 180cm z przylepcem-1 szt,
- serwetę 90cm x 75 cm z przylepcem - 2 szt,
- serwetę na stół instrumentalny 190cm x 150cm-1 szt,
- serwetę na stolik Mayo 145cm x 80 cm- 1 szt,
- serwetki włókninowe do rąk 4 szt.

Na opakowaniu znajdują się 4 samoprzylepne naklejki z informacjami: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. **Pakiet 18, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 140cm x 80cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

8. **Pakiet 18 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści dwuwarstwowy, jałowy, jednorazowy zestaw uniwersalny w składzie:

- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
- e) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

- f) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Lub

Czy zamawiający dopuści dwuwarstwowy, jałowy, jednorazowy zestaw uniwersalny w składzie:

- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d) 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm
- e) 2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm
- f) 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175 cm x 170 cm
- g) 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

9. **Pakiet 18, pozycja 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie trzywarstwowego (polipropylen/polietylen/polipropylen), jałowego, jednorazowego zestawu uniwersalnego o gramaturze 66 g/m² o składzie: serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm - 1 szt. , serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm - 1 szt., serweta górna przylepna 160 x 260 cm - 1 szt., serweta dolna przylepna 196 x 200 cm - 1 szt., serweta boczna przylepna 75 x 98 cm - 2 szt. , uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm - 1 szt., ręcznik chłonny 20 x 30 cm - 4 szt. Na opakowaniu 3 samoprzylepne naklejki z informacjami: nr katalogowy, nr LOT, data ważności i nazwa producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

10. **Pakiet 18, pozycja 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetą na stolik Mayo w rozmiarze 142 x 80 cm w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

11. **Pakiet 18, pozycja 2:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwetki na stolik Mayo w rozmiarze 142 x 80 cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

12. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 18, pozycji 1 dopuści Jednorazowy zestaw uniwersalny, o gramaturze od 56 g/m² – 62 g/m² (zamiast o gramaturze od 56 g/m² – 60 g/m²) wykonany z włókniny, z jednej strony posiadający folię polietylenową, zabezpieczającą przed przesiąkaniem, z drugiej strony chłonną włókninę polipropylenową, odporny na rozdieranie. Pozostałe rozmiary w granicach tolerancji?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

13. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 18, pozycji 1, 2 serwetki na stolik Mayo sterylnej o rozmiarze 80 x 140 cm (zamiast 80 x 145 cm). Pozostałe rozmiary w granicach wyznaczonych przez Zamawiającego?


Odpowiedź: Dopuszczamy.

14. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 18, pozycji 1 zestaw uniwersalny serwetki z przyklepcem o rozmiarze 170 x 200 cm lub 180 x 200 cm (zamiast tolerancji rozmiaru 170-180 x 170-180 cm). Pozostałe rozmiary w granicach wyznaczonych przez Zamawiającego)?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 19

1. **Pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwetki do znieczulenia zewnętrżozponowego o następujących parametrach:



Serweta epiduralna
transparentna PE, perforowana

Skład zestawu:


Serweta do znieczulenia
przezroczysta, PE, perforowana, przy-
lepna, otwór typu romb 9 x 12 cm 90 x 120

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. **Pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zapięcia na rzep w rozmiarze 2 x 23 cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. **Pozycja 4:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do litotomii wykonanego z dwuwarstwowego laminatu (włóknina – folia) o gramaturze 55 g/m², obszary wzmocnione 110 g/m² w następującym składzie:

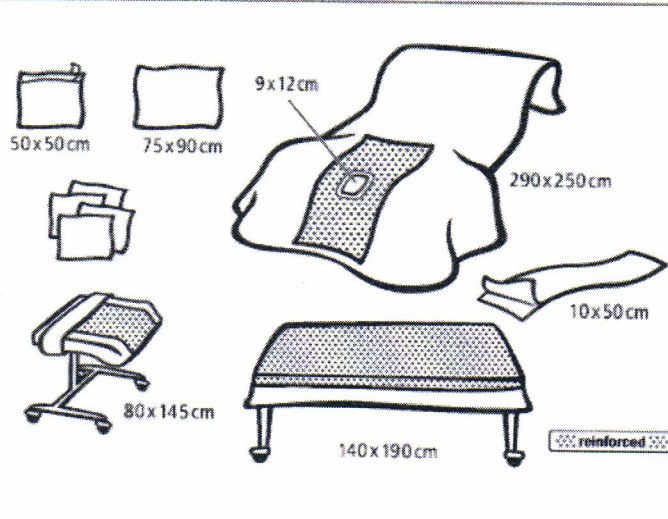

Zestaw ginekologiczny II wzmocniony	
Skład zestawu:	
1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm)	290 x 250
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladek	75 x 90
1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu	50 x 50
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. **Pakiet 19 poz. 4** Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta do litotomii ma rozmiar 180cm x 245cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 22

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 22 prześcieradła z chłonnej włókniny wiskozowej (28g/m²) pokrytej folią (20g/m²) i warstwą celulozy (20g/m²)?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 22 prześcieradła o szerokości 70cm?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 22 prześcieradła o szerokości 80cm?


Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

4. **Pakiet 22 poz. 1** Czy Zamawiający wymaga prześcieradeł składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka pakowane po 10 szt..
Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prześcieradła ofoliowane o gramaturze min. 43g/m²?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 24

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii w poniższym składzie, spełniającego parametry techniczne:
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
 - 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
 - 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
 - 1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), otwór 31 x 35 cm, warstwa chłonna 5 x 80 cm, organizatory przewodów
 - 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

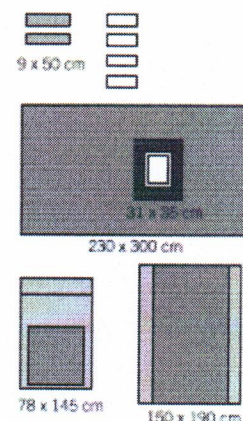

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. **Pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii w ułożeniu litotomijnej spełniającego wymogi SIWZ posiadającego w swoim składzie 4 ręczniki celulozowe zamiast 2 szt. ?

Odpowiedź: Dopuszczamy. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

3. **Pakiet nr 24:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do laparoskopii w którym serweta do zabiegów laparoskopii jest o min. wymiarach 260x300cm z przylepnym oknem 28x30x24cm, ze zintegrowanymi nogawicami i dwiema przezroczystymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne. Zestaw posiada dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Dopuszczamy. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

4. **Pakiet 24, pozycja 1** - Czy zamawiający dopuści jednorazowe, sterylne obłożenie pola operacyjnego do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym wykonane z 2 warstw o gramaturze materiału 56 g/m², posiadające dodatkowe wzmocnienia wokół pola operacyjnego, folia polietylenowa na całej powierzchni.

W skład zestawu wchodzi:

- 1) serweta na stół narzędziowy od 140 x 190 cm ze wzmocnieniem,
- 2) obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem,
- 3) serweta do zabiegów laparoskopii zintegrowana z nogawicami i organizatorami przewodów 200/270cm x 300cm (okno 25 x 30 cm),
- 4) 4 ręczniki.
- 5) taśma lepna

6) pokrowiec na przewody 14 x 250 cm

7) tama typu rzep

Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. **Pakiet 24:** Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do laparoskopii w pozycji litotomijnej w składzie:

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm

c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

d) 1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260x310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwyty do przewodów i drenów? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 25

1. Pozycja 1-5: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby produkty w pozycjach od 1-5 były opatrzone trwale nazwą producenta lub wytwórcy? Zważywszy na to, że produkty opisane przez Zamawiającego w pozycjach od 1-5 posiada na rynku polskim jedynie jedna firma. Nie odstąpienie od wymogu skutkować będzie wystartowaniem w pakiecie 25 jedynie jednego wykonawcy, co zaburza zasadę uczciwej konkurencji. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że nazwa producenta/wytwórcy znajduje się na opakowaniu jednostkowym a produkt stosowany jest przez wykwalifikowany personel medyczny. Jeżeli Zamawiający potrzyma wymóg, zwracamy się z ustawowym prawem o wyjaśnienie, w jakim celu Zamawiający wymaga oznakowania produktów nazwą producenta lub wytwórcy?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje w Pakiecie nr 25 w pozycjach 1-5 od wymogu, aby produkty w pozycjach od 1-5 były opatrzone trwale nazwą producenta lub wytwórcy. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

2. Pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prześcieradło barierowe w rozmiarze 150x101 cm (+/- 2cm), wyposażony w rdzeń chłonny umieszczony centralnie w rozmiarze 50x125?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

3. Pozycja 6: Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji 6 z Pakietu nr 25.

4. Pozycja nr 2 – Zwracamy się z prośbą do zamawiającego czy dla potwierdzenia wymaganej chłonności, oczekuje badań z akredytowanego laboratorium opartego na znormalizowanej metodzie o dokładności +/- 5 %.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumenty określone w siwz w tym, opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis, potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ w szczególności w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (odpowiedni do zakresu złożonych pakietów).

Pytania do Pakietu nr 26

1. **Pakiet 26, pozycja 1-2:** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby podkład produkowany był w warunkach spełniających wymagania ISO 9001, ISO 13485 oraz ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem).


Odpowiedź: Tak.

2. **Pakiet 26, pozycja 2:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ze względu na przeznaczenie prześcieradła dla osób unieruchomionych, trwale leżących, ma ono być przepuszczalne dla powietrza ze wskaźnikiem WVTR min. 3600 g/m²/24godz?

Odpowiedź: Tak.


Pytania do Pakietu nr 28

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii w poniższym składzie, spełniającego parametry techniczne:
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
 - 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
 - 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
 - 1 osłona na nogę 36 x 65 cm wykonana z kratonu
 - 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 75 x 80 cm i organizatorami przewodów
 - 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

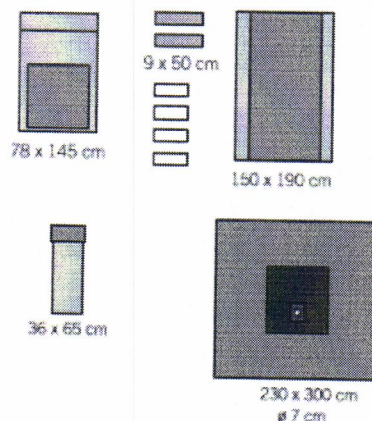

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. **Pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego z dwuwarstwowego laminatu (włókna – folia) o gramaturze 55 g/m², obszary

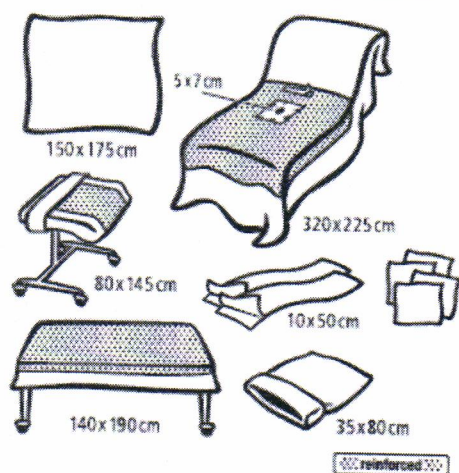

Zestaw do zabiegów na kończynie I wzmocniony

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm)	320 x 225
1 serweta nieprzylepna	150 x 175
1 osłona na kończynę	35 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

wzmocnione 110 g/m² w następującym składzie:

Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. **Pakiet nr 28:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do artroskopii kolana na kończynie, w którym serweta główna jest o min. wymiarach 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne otwory, torba do zbiórki płynów z zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”), 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm, 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm, dodatkowo zestaw zawiera 1 dwukomorową kieszeń na instrumenty chirurgiczne oraz 1 dren 150 cm. Zestaw posiada dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. **Pakiet 28, pozycja 1** - Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do artroskopii parametry zgodne z SIWZ w składzie :

serweta o wymiarach co najmniej 230 x 300 cm z otworem o średnicy 7 cm,
jedna osłona na kończynę 22 cm x 75 cm z **elastycznego neoprenu**,
trzy taśmy przylepna,
dwie serwety o wymiarach 150 cm x 190 cm ,
serweta na stolik Mayo 80cm x 145 cm
cztery ręczniki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. **Pakiet 28:** Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do artroskopii kolana w składzie:

- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
 - d) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
 - e) 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
 - f) 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
 - g) 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?
- Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. **Pakiet 28:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącego się rozmiarami zestawu: serweta główna w rozmiarze 200 x 300 cm z elastycznych samouszczelniającym się otworem o średnicy 5 cm, osłona na kończynę w rozmiarze 36,5 x 72 cm, serweta 152 x 190 cm 2 szt, serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm, taśma lepna, 2 ręczniki chłonne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. **Pakiet 28 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści obłożenie, w którym osłona na kończynę ma wymiar 75cm x 37cm oraz serweta o wymiarach co najmniej 150cm x 180cm ma wymiar 150cm x 190cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.


Odpowiedź: Dopuszczamy.

8. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 28, pozycji 1 serwety na stolik Mayo sterylnej o rozmiarze 80 x 140 cm (zamiast 80 x 145 cm). Pozostałe rozmiary w granicach wyznaczonych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 30

1. **Pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji na tarczycy wykonanego z dwuwarstwowego laminatu (włóknina – folia) o gramaturze 55 g/m², obszary wzmocnione 110 g/m² w następującym składzie:

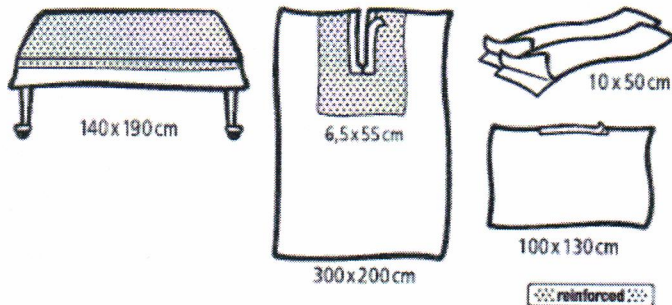

Zestaw do operacji głowy i szyi
wzmocniony

Skład zestawu:

1 serwetka na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 samoprzylepna serwetka operacyjna z padem chłonnym, typu "U" (6,5 x 55 cm)	200 x 300
1 samoprzylepna serwetka operacyjna	100 x 130
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50

Opakowanie dodatkowe - papier krepowy

Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga zestawu do zabiegów na tarczycy w składzie:

1. serwetka chirurgiczna o wymiarach 200/280x350 cm z otworem samoprzylepnym o wymiarach 11x11 cm	200/280x350	1
2. taśma samoprzylepna typu RZEP	2,5x30	1
3. taśma samoprzylepna	9x49	1
4. ręczniki chłonne	18x25	4
5. osłona na stolik MAYO	79x145	1
6. serwetka na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 31

1. **Pakiet 31, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłon na kończyny w rozmiarze 70 x 120cm wykonane z 3 warstwowej włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. **Pakiet 31:** Czy Zamawiający dopuści osłony o rozmiarze 120cm x 37cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 33

1. Wnosimy o dopuszczenie maty wysokochłonnej o wymiarach 72x37cm lub 57x 37cm posiadającą absorbent umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu.

Odpowiedź: Dopuszczamy wymiar 72 x 37 cm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 34

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 35g/m² spełniającego warunek pełnobarierowości, z włókniny SMMMS?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch operacyjny o gramaturze 35g/m²?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
3. Pakiet nr 34: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha operacyjnego, jednorazowego, jałowego, pełnobarierowego z włókniny typu SMMMS o gramaturze min.35g/m², pozostałe parametry zgodne?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
4. **Pakiet 34, pozycja 1** - Czy zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMMMS pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
5. **Pakiet 34:** Czy zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny, pełno barierowy, z włókniny SMMS o gramaturze minimum 35g/m²? Rozmiar M-L, XL,XXL. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
6. Pakiet 34: Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź:

Pytania do pakietów nr: dotyczy Pakiet nr 1,3,18,24,28

1. Czy Zamawiający mając na uwadze dobro pacjenta oczekuje od Wykonawców zaoferowanie obłożeń nie zawierających pyłących włókien wiskozy i celulozy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do pakietów nr: dotyczy Pakiet nr 1,3,6,11,18,24,28,31,34

1. Czy Zamawiający oczekuje, aby asortyment zapakowany był w opakowanie pośrednie kartonowe – dispenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do SIWZ

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę w zakresie Pakietu nr 14.

Zmiana zapisów SIWZ:

IX. KRYTERIA WYBORU OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY w zakresie:

Pakiety od 1 do 13; od 15 do 36

W zakresie kryterium „**TERMIN DOSTAWY**” maksymalną ilość punktów (40 pkt.) otrzyma oferta z najkrótszym terminem dostawy, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Ocena punktowa badanej oferty} = \frac{\text{Termin dostawy oferty z najkrótszym terminem dostawy}}{\text{Termin dostawy oferty badanej}} \times 100 \times 40 \%$$

Zaoferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.

W przypadku nie wypełnienia tego punktu w Formularzu Ofertowym Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje termin dostawy – 5 dni roboczych).

Pakiet nr 14

W zakresie kryterium „**TERMIN DOSTAWY**” maksymalną ilość punktów (40 pkt.) otrzyma oferta z najkrótszym terminem dostawy, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Ocena punktowa badanej oferty} = \frac{\text{Termin dostawy oferty z najkrótszym terminem dostawy}}{\text{Termin dostawy oferty badanej}} \times 100 \times 40 \%$$

Zaoferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych.

W przypadku nie wypełnienia tego punktu w Formularzu Ofertowym Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje termin dostawy – 10dni roboczych).

Zmiana zapisu projektu umowy:

§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dostawy są realizowane w terminie nie dłuższym niż (max 5 dni roboczych – Pakiety od nr 1 do 13; od nr 15 do 36; max 10 dni roboczych – Pakietu nr 14) dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę. „

3. **Dotyczy Formularza Ofertowego i Cenowego:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z FO oraz FC pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
-

Pytania do projektu umowy:

1. Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o modyfikację § 3 ust. 13 oraz § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu do 14 dni.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
2. Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 1 % w § 7 ust. 1 pkt 2).
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
3. Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 1 pkt 1) lit. b), c), d) projektu umowy poprzez określenie, że kary umowne w zastrzeżonej wysokości naliczane będą od wartości brutto niedostarczonego/reklamowanego towaru, a nie od wartości brutto przedmiotu umowy.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
4. Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 1 pkt 3) i 4) projektu umowy poprzez określenie, że kary umowne w zastrzeżonej wysokości naliczane będą od wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
5. Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 8 ust. 1 pkt 9) o następującej treści: „w zakresie zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

6. Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie do § 9 ust. 3 następującego zapisu: „Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

7. Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie zapisu § 11 ust. 1 zdanie pierwsze projektu umowy.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

8. **Dotyczy § 3 ust. 10.1 wzoru umowy** W § 3 ust. 10.1 wzoru umowy jest zapis: „1. Uzupetnić braki ilościowe.....w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin w dni robocze, Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 48 godzin na uzupełnienie braków ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 4 dni roboczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9. **Dotyczy § 7 ust. 1 /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wzoru umowy:** Wnosimy o zmianę zapisu umowy na:

1) 0,1 % wartości brutto **niezrealizowanej** części dostawy , o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w: § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, § 3 ust. 10 pkt 1, § 3 ust. 10 pkt 2;

2) 0,5% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek uchybienia przez wykonawcę któremukolwiek z obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 2 lub 3,

3) 10% wartości brutto **niezrealizowanej części umowy w przypadku** odstąpienia od Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

4) 10 % wartości brutto **niezrealizowanej części umowy**, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

10. Dotyczy §3 ust. 10 pkt. 1 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:?

Wykonawca zobowiązuje się:

1) uzupełnić stwierdzone przez Zamawiającego braki ilościowe w otrzymanym Towarze w terminie do **72** godzin w dni robocze;

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Zmiana zapisów SIWZ:

§3 ust. 10 pkt. 1 projektu umowy otrzymuje brzemienie:

„Wykonawca zobowiązuje się:

1) uzupełnić stwierdzone przez Zamawiającego braki ilościowe w otrzymanym Towarze w terminie do 72 godzin w dni robocze,

2) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 96 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 48 godzin w dni robocze, dostarczenia Towaru wolnego od wad.”

11. Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

12. Czy nieograniczona odpowiedzialność, o której mowa w § 2 ust. 3 wzoru umowy, oznacza odpowiedzialność na zasadach Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń umownych?

Treść § 2 ust. 3 wzoru umowy jest niezrozumiała i wymaga doprecyzowania.

Odpowiedź: Tak.

13. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 15 wzoru umowy wyrażenie „nie krótszy, niż 24 miesiące” zostało zastąpione wyrażeniem „nie krótszy niż 12 miesięcy”?

Spełnienie wymogu 2-letniego terminu przydatności do użycia jest możliwe, ale wymagałoby zorganizowania specjalnej obsługi dostaw specjalnie dla Zamawiającego, co zwiększałoby koszty logistyczne związane z obsługą dostaw i miałyby niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na wysokość oferowanej ceny. Nasuwa się wątpliwość czy wymaganie tak długiego terminu przydatności do użycia jest rzeczywiście uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Czy Zamawiający zamierza przechowywać zakupione towary przez 2 lata?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Zmiana SIWZ:

§ 3 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„Okres ważności dostarczonych Towarów jądowych nie może być krótszy, niż 12 miesiące od dnia odbioru dostawy. Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr serii i data ważności.”

14. O jakich elementach koniecznych do wykonania procedury jest mowa w § 4 ust. 5 wzoru umowy? O jakim oszacowaniu ilości jest mowa w § 4 ust. 5 wzoru umowy? Czy Zamawiający oczekuje, że dostawy towarów będą zawierały inne elementy lub ilości, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia? Czy obciążenie kosztami, o którym mowa w § 4 ust. 5 wzoru umowy, dotyczy wyłącznie przypadków dostaw niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia?

Treść § 4 ust. 5 wzoru umowy jest niezrozumiała i wymaga modyfikacji.

Odpowiedź: Z paragrafu 4 zostaje wykreślony ustęp 5.

15. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

16. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

17. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niestuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

18. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „0,1% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,” zostało zastąpione wyrażeniem „0,1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowna to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także

w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzi w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę."


Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

19. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 3) i 4) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Krystyna Kulesza-Hurwi