

Białystok, dnia 30.10.2017r.

Nr pisma: DA.ZP.242.84.2.2017

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elektrycznych łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych metalowych, znak postępowania: DA.ZP.242.84.2017.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy Pakietu nr 1 - Elektryczne łóżka szpitalne (42 szt.)

1. Czy Zamawiający w pkt 4. dopuści łóżko gdzie, maksymalna wysokość wynosi 815 mm umożliwiającą ustawienie łóżka do pozycji egzaminacyjnej (do badań), co jest niewielką różnicą w stosunku do wymagań Zamawiającego i nie ogranicza funkcjonalności łóżka?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający w pkt 4. dopuści łóżko gdzie, maksymalna wysokość wynosi 790 mm umożliwiającą ustawienie łóżka do pozycji egzaminacyjnej (do badań), co jest niewielką różnicą w stosunku do wymagań Zamawiającego i nie ogranicza funkcjonalności łóżka?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający w pkt 5. dopuści łóżko jako parametr równoważny nanotechnologię nanocząsteczek dwutlenku tytanu (TiO₂) w postaci nanoszenia jej na gotowy produkt. Opisana przez Państwa metoda, która ma być integralną zawartością składu tworzywa i składu lakieru w częściach metalowych nie gwarantuje całemu produktowi zabezpieczenia przeciwbakteryjnego. W oferowanej przez nas metodzie nanoszenia nanocząstek wszystkie elementy są poddane zabezpieczeniu włącznie przede wszystkim z pilotem pacjenta, które są największym nośnikiem bakterii, wirusów a powolne jej uwalnianie wygląda tak sam jak w wymaganej przez Państwa technologii. Skuteczność nanoszenia nanocząsteczek dwutlenku tytanu potwierdzona jest certyfikatem, a opisywana przez nas nanotechnologia jest obecnie najpopularniejszą metodą na świecie?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający w pkt 10. dopuści tóżko gdzie występuje płynna elektryczna regulacja oparcia pleców za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 0° do min. 72° co jest niewielką różnicą w stosunku do wymagań Zamawiającego i nie ogranicza funkcjonalności tóżka?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. Czy Zamawiający może wyjaśnić co rozumie w pkt 11. poprzez sformułowanie „totalny system hamulcowy na każdym z kótek” ?? Sformułowanie to ma charakter marketingowy i nie opisuje parametrów technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający w pkt 11 ma na myśli blokadę indywidualną na każdym kółku.

6. Czy Zamawiający w pkt 15. dopuści tóżko gdzie elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga wynosi 16° ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne tóżka elektryczne, które posiadają wymiary leża wynoszące 850×2010 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego przez Zamawiającego i nie ma wpływu na funkcjonalność tóżek?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne tóżka elektryczne, które posiada całkowitą szerokość z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi wynoszącą 975 mm? Parametr ten jest tylko o 5 mm szerszy od parametru wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne tóżka elektryczne, które posiadają elektryczną regulację wysokości leża w zakresie $315 - 800$ mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne tóżka elektryczne, które posiadają elektryczną regulację oparcia pleców w zakresie $0^{\circ} - 74^{\circ}$?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne tóżka elektryczne, które posiadają elektryczną regulację segmentu uda w zakresie $0^{\circ} - 27^{\circ}$?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne łożka elektryczne, które posiadają elektryczną regulację pozycji anty – Trendelenburga w zakresie 15°?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

13. Czy Zamawiający dopuści łożka o szerokości 990 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

14. Czy Zamawiający dopuści łożka o długości leża 1950 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

15. Czy Zamawiający dopuści łożka o maksymalnej wysokości leża 740 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

16. Czy Zamawiający dopuści jako parametr równoważny nanotechnologię nanocząsteczek dwutlenku tytanu (TiO₂) w postaci nanoszenia jej na gotowy produkt. Opisana przez Państwa nanotechnologia, która ma być integralną zawartością składu lakieru w częściach metalowych nie gwarantuje całemu produktowi zabezpieczenia przeciwbakteryjnego. W naszej metodzie nanoszenia wszystkie elementy są poddane zabezpieczeniu włącznie z pilotem pacjenta, które to są największym nośnikiem bakterii i wirusów, a powolne jej uwalnianie następuje w ten sam sposób jak przy metodzie opisanej przez Państwa. Opisywana przez nas nanotechnologia jest obecnie najpopularniejszą metodą na świecie.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

17. Czy Zamawiający dopuści łożko o konstrukcji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo bez użycia lakieru o właściwościach antybakteryjnych?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

18. Czy Zamawiający dopuści łożko z leżem wypełnionym odejmowanymi, tworzywowymi panelami?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

19. Czy Zamawiający dopuści łożko wyposażone w pilota z mechaniczną blokadą funkcji z jedną diodą świecącą się na zielono gdy pilot jest zasilany elektrycznie i gotowy do użycia, świecącą się na czerwono gdy pilot jest zablokowany?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty-Trendelenburga 16°?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

21. **Czy zamawiający zaakceptuje łóżko o poniższych parametrach:**

Wymiary zewnętrzne: 2150 x 950 mm .

Wymiary leża: 2000x870 mm

Regulacja segmentu pleców, uda oraz pozycji TB/ATB regulowana za pomocą przewodowego podświetlanego pilota zawieszanego np. na barierkach łóżka.

Elektrycznie regulowana wysokość łóżka w zakresie 360-720 mm

Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym.

Profile łóżka typu ERW wykonane ze stalowych prostokątnych tub .

Czterosegmentowe leże pacjenta wykonane z odejmowanych paneli wykonanych z polipropylenu odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych oraz działanie UV.

Każdy segment wyposażony w jeden panel wyposażony w otwory wentylacyjne. Segmenty leża zaokrąglone.

Kąt uniesienia oparcia pleców 75°, kąt uniesienia uda: 45°

TB/ATB: 18°

Szczyty wykonane z łatwozmywalnego ABS z możliwością odjęcia szczytów bez użycia narzędzi.

Zintegrowane płaskie odbojniki ze szczytami, chroniące łóżko na całej długości.

Barierki – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane ze stopu aluminium. Barierka, stojak kroplówki, korby kolorystycznie dopasowane do wypełnienia szczytów

Dwupozycyjne barierki boczne , posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta. Podnoszenie barierki bocznych regulowane przy pomocy bezpiecznego przycisku.

Pewność bezpiecznego zamknięcia mechanizmu sygnalizowana „kliknięciem”

Koła blokowane centralnie o średnicy :150 mm, cichobieżne w obudowie przeciwpływowej.

Dwa uchwyty na woreczki na treści pacjenta, stojak na kroplówkę do zamontowania w 4 miejscach na łóżku .

Stojak kroplówki montowany niezależnie do odrębnych otworów niż rama ortopedyczna

Dodatkowo ręczna dźwignia CPR zlokalizowana w segmencie oparcia pleców po obydwu stronach.

Bezpieczne obciążenie: 250 kg.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

22. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym leże ma szerokość 840 mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

23. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości 410-810 mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

24. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją anty-Trendelenburga 0-15 °?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

25. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytem bez kolorowych wkładek?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Czy zamawiający dopuści barierki boczne montowane bez użycia narzędzi do specjalnych tulei za pomocą pokręteł?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

26. Czy Zamawiający dopuści łóżko z płynną elektryczną regulacją oparcia pleców za pomocą pilota przewodowego z zakresie od 0 ° do 70 ° ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

27. Czy zamawiający dopuści pilot z mechaniczną blokadą funkcji, z trzema diodami :

- pierwsza dioda świecąca w kolorze pomarańczowym w trakcie wykonywania żądanego ustawienia łóżka,

- druga dioda (kilku funkcyjna) świecąca w kolorze pomarańczowym, gdy wszystkie funkcje są odblokowane, świecąca na kolor zielony, gdy aktywna jest regulacja wysokości leża, a pozostałe funkcje są zablokowane oraz nieemitująca światła w trakcie zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych,

- trzecia dioda świecąca w kolorze zielonym informująca o posiadaniu przez łóżko zasilania – czyli gotowości do pracy ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

28. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2200 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

29. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże o wymiarach 860 x 1980 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

30. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości leża od podłogi: minimalna wysokość łóżka od podłogi 415 mm umożliwiającą komfortowe opuszczanie łóżka przez pacjenta bez względu na stan zdrowia oraz wzrost, maksymalna wysokość 815 mm umożliwiającą ustawienie łóżka do pozycji egzaminacyjnej (do badań)?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

31. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego segmenty leża są wypełnione płytami HPL w kolorze leża?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

32. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację następujących funkcji z pilota przewodowego: wysokości leża, segmentu oparcia pleców, segmentu ud, Trendelenburga i anty-Trendelenburga, autokontur; pilot z mechaniczną blokadą funkcji z dwiema diodami – dioda świecąca na żółto gdy funkcja na pilocie jest zablokowana, dioda świecąca na zielono gdy funkcja na pilocie jest odblokowana?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

33. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające płynną regulację oparcia pleców za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 0° do 70°?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

34. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające segment podudzia stabilizowany systemem zapadkowym – rastomat, kąt pomiędzy segmentem podudzia, a płaszczyzną poziomą regulowany w zakresie od 0° do 18°??

Odpowiedź: Dopuszczamy.

35. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w totalny system hamulcowy tj. centralna blokada kółek, 4 koła o średnicy 150 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.


36. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację pozycji Trendelenburga 13°?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

37. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację pozycji anty-Trendelenburga 14°?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby producent przedstawił oświadczenie potwierdzające antybakteryjność lakieru? Zgodnie z zapisami w pkt. 5 Zamawiający wymaga, aby dodatki były tylko integralną zawartością składu lakieru.

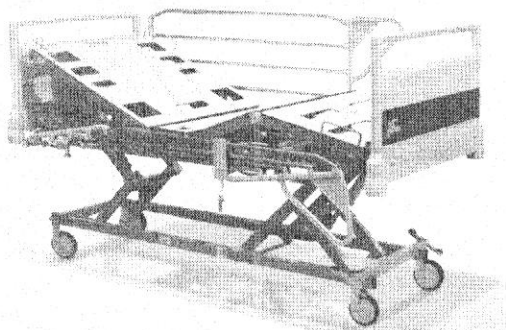

(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające wysokość maksymalną leża 810 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami z płyty HPL odpornej na działanie wysokiej temperatury, środki dezynfekcyjne ora działanie UV?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami z siatki stalowej lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot z mechaniczną blokadą funkcji z trzema osobnymi diodami:

- dioda świecąca na zielono gdy układ elektryczny jest zasilany elektrycznie
- dioda świecąca na pomarańczowo podczas używania pilota
- realizacji wybranej funkcji - dioda świecąca na pomarańczowo gdy pilot odblokowany

Odpowiedź: Dopuszczamy.

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne zapewniające możliwość przekładania ich pomiędzy łózkami bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi, mocowane do ramy leża za pomocą zacisku zabezpieczonego pokrętkiem śrubowym?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 2 Szafki przyłóżkowe metalowe (50 szt.)

1. Czy Zamawiający w pkt 1 dopuści szafkę o wysokości całkowitej 840 mm, co jest niewielką różnicą w stosunku do wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający w pkt 2 dopuści szafkę o szerokość 560 mm, co jest niewielką różnicą w stosunku do wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający w pkt 3 dopuści szafkę o głębokości 410 mm, co jest niewielką różnicą w stosunku do wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający w pkt 8 dopuści szafkę z szufladą na prowadnicach suwnych, w szufladzie tworzywowy wkład?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. Czy Zamawiający w pkt 11 dopuści szafkę z blatem bocznym i głównym wykonanymi z tworzywa ABS ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Czy Zamawiający w pkt 12 dopuści szafkę z blatem bocznym blatem bocznym obrotowym o wymiarach 550x320mm z regulowaną wysokością w zakresie 718-1180mm.?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. Czy Zamawiający wymaga, żeby oferowana szafka zabezpieczona posiadała zabezpieczenie antybakteryjne, analogicznie do łóżek ? Wymóg taki wydaje się logiczny ponieważ wyposażenie to będzie bezpośrednio się ze sobą stykało i będzie miało kontakt z wieloma osobami? Czy w tym przypadku Zamawiający dopuści zastosowanie nanoszenia nanotechnologii nanocząsteczek dwutlenku tytanu (TiO₂)?

Odpowiedź: Nie wymagamy.

8. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości całkowitej 880 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

9. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości kontenera 840 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

10. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 550 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

11. Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 450 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

12. Czy Zamawiający dopuści szafkę z korpusem szafki wykonanym z blachy pokrytej farbą proszkową i profili aluminiowych?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

13. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w jedną szufladę o wysokości 110 mm i drugą szufladę o wysokości 350 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

14. Czy Zamawiający dopuści szafkę z wolną przestrzenią między szufladami o wysokości 190 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

15. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 500 x 300 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

16. Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 810 do 1060 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

17. Czy Zamawiający dopuści szafkę z płynną regulacją wysokości blatu bocznego odbywającą się przy pomocy sprężyny gazowej ostioniętej aluminiową kolumną?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

18. Czy w rozumieniu pkt 1 Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości całkowitej 800mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

19. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 620mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

20. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą o wysokości 90mm oraz drzwiczkami o wymiarach 330x330mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o wysokości 90 mm. Zamawiający po zmianie SIWZ wprowadzonym pismem nr DA.ZP.242.84.12017 z dnia 27.10.2017r. nie określa wymiarów drzwiczek.

21. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z wolną przestrzenią pomiędzy szufladą i komorą wynoszącą 110mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

22. Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą na prowadnicach rolkowych?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

23. Czy Zamawiający dopuści szafkę przytóżkową bez półki wewnątrz zamykanej komory?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

24. Czy Zamawiający dopuści blat boczny o wymiarach 520x360mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

25. Czy Zamawiając dopuści regulację blatu bocznego w zakresie 800x1200mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

26. Czy Zamawiający dopuści szafkę przytóżkową, w której wewnętrzna rurka od regulacji blatu bocznego jest malowana proszkowo?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przytóżkowej o wysokości całkowitej wynoszącej 825 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

28. Prosimy o udzielenie dodatkowej informacji, czy poprzez zapis w punkcie nr 2 tabeli technicznej należy rozumieć wysokość górnej krawędzi kontenera zamykanego drzwiczkami, czy wysokość szafki do górnej krawędzi blatu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przytóżkowej z kontenerem umieszczonym na wysokości 600 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przytóżkowej z kontenerem umieszczonym na wysokości 825 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przytóżkowej o szerokości 570 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przytóżkowej o głębokości 440 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przytóżkowej wyposażoną w komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach 340 mm x 360 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ po zmianach - pismo nr DA.ZP.242.84.12017 z dnia 27.10.2017r.

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przytóżkowej posiadającą między szufladą i komorą wolną przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości 105 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ po zmianach - pismo nr DA.ZP.242.84.12017 z dnia 27.10.2017r.

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przytóżkowej z szufladą na prowadnicach rolkowych?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przytóżkowej z blatem bocznym składanym do boku szafki, nieobrotowym?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przytóżkowej z blatem bocznym o wymiarach 530 mm x 340 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przytóżkowej z blatem bocznym regulowanym w zakresie od 740 do 1130 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przytóżkowej z blatem bocznym z płynną regulacją jego wysokości przy pomocy dwóch współpracujących ze sobą rur zewnętrznych i wewnętrznych lakierowanych proszkowo?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Dotyczy zapisów siwz, warunków realizacji zamówienia

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji Zamówienia do 20.12.2017 roku?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz, tj.: zamówienie będzie realizowane w terminie do dnia 18.12.2017r. od dnia zawarcia umowy.

2. Czy zamawiający zaakceptuje 8 tygodniowy termin realizacji umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz tj.: zamówienie będzie realizowane w terminie do dnia 18.12.2017r. od dnia zawarcia umowy.

3. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 7 tyg. od podpisania umowy i podania kolorystyki?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz, tj.: zamówienie będzie realizowane w terminie do dnia 18.12.2017r. od dnia zawarcia umowy.

4. Mając na względzie zgodność treści Oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z treścią wymogów zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ w Części B, zwracamy się do Zamawiającego o zmianę fragmentu treści Załącznika nr 3 do SIWZ na następującą:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt.13 – 14, 16 – 20 lub art. **24 ust. 5 pkt. 1** ustawy Pzp – jeżeli dotyczy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 3 do siwz - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania. Wyżej wymieniony załącznik po zmianach w załączeniu do niniejszego pisma. Poniżej Zamawiający wskazuje miejsce, w którym został zmodyfikowany załącznik (pogrubiona czcionka).

Zamiast:

„Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

Powinno być:

„Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. **24 ust. 5 pkt. 1** ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....”

Dotyczy projektów umów

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenia kar umownych w §14 ust. 1 pkt. 1 z 0,2% na 0,1% wartości brutto umowy, określonej w §9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy względem terminów określonych w Umowie, a w szczególności w:

- §2 ust. 2 pkt. 5;

- §6 ust. 1;

- §8 ust. 2;
- §10 ust. 4;
- §11 ust. 2 – 4;
- §11 ust. 8.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenia kar umownych w §14 ust. 1 pkt. 2 z 2% na 0,1% wartości brutto umowy, określonej w §9 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi określonymu w §11 ust. 9 – 10 lub §12 ust. 3? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenia kar umownych w §14 ust. 1 pkt. 3 z 5% na 0,1% wartości brutto umowy, określonej w §9 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia warunkom określonym w §2? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, zgodnie z projektami umów.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenia kar umownych w §14 ust. 1 pkt. 4 z 5% na 0,1% wartości brutto umowy, określonej w §9 ust. 1 za każdy niedostarczony w terminie dokument określony w §8 ust. 2? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis w §14 ust. 1 pkt. 4 w Załączniku nr 6A do siwz – projekt umowy (Pakiet nr 1) oraz wykreśla zapis w § 10 ust. 1 pkt 2 w Załączniku nr 6B do siwz – projekt umowy (Pakiet nr 2).

Załącznik do pisma:

Załącznik nr 3 do siwz - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania po zmianach.

UWAGA: Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie wszystkich zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz
mgr Joanna Zaręba-Słoma